INTUBACIÓN | INTERCAMBIO PARA VÍA AÉREA | VÍA AÉREA DE URGENCIA | EXTUBACIÓN

Hay casos en los que saber gestionar el tiempo es una cuestión vital. ¿Cuáles son sus estrategias?

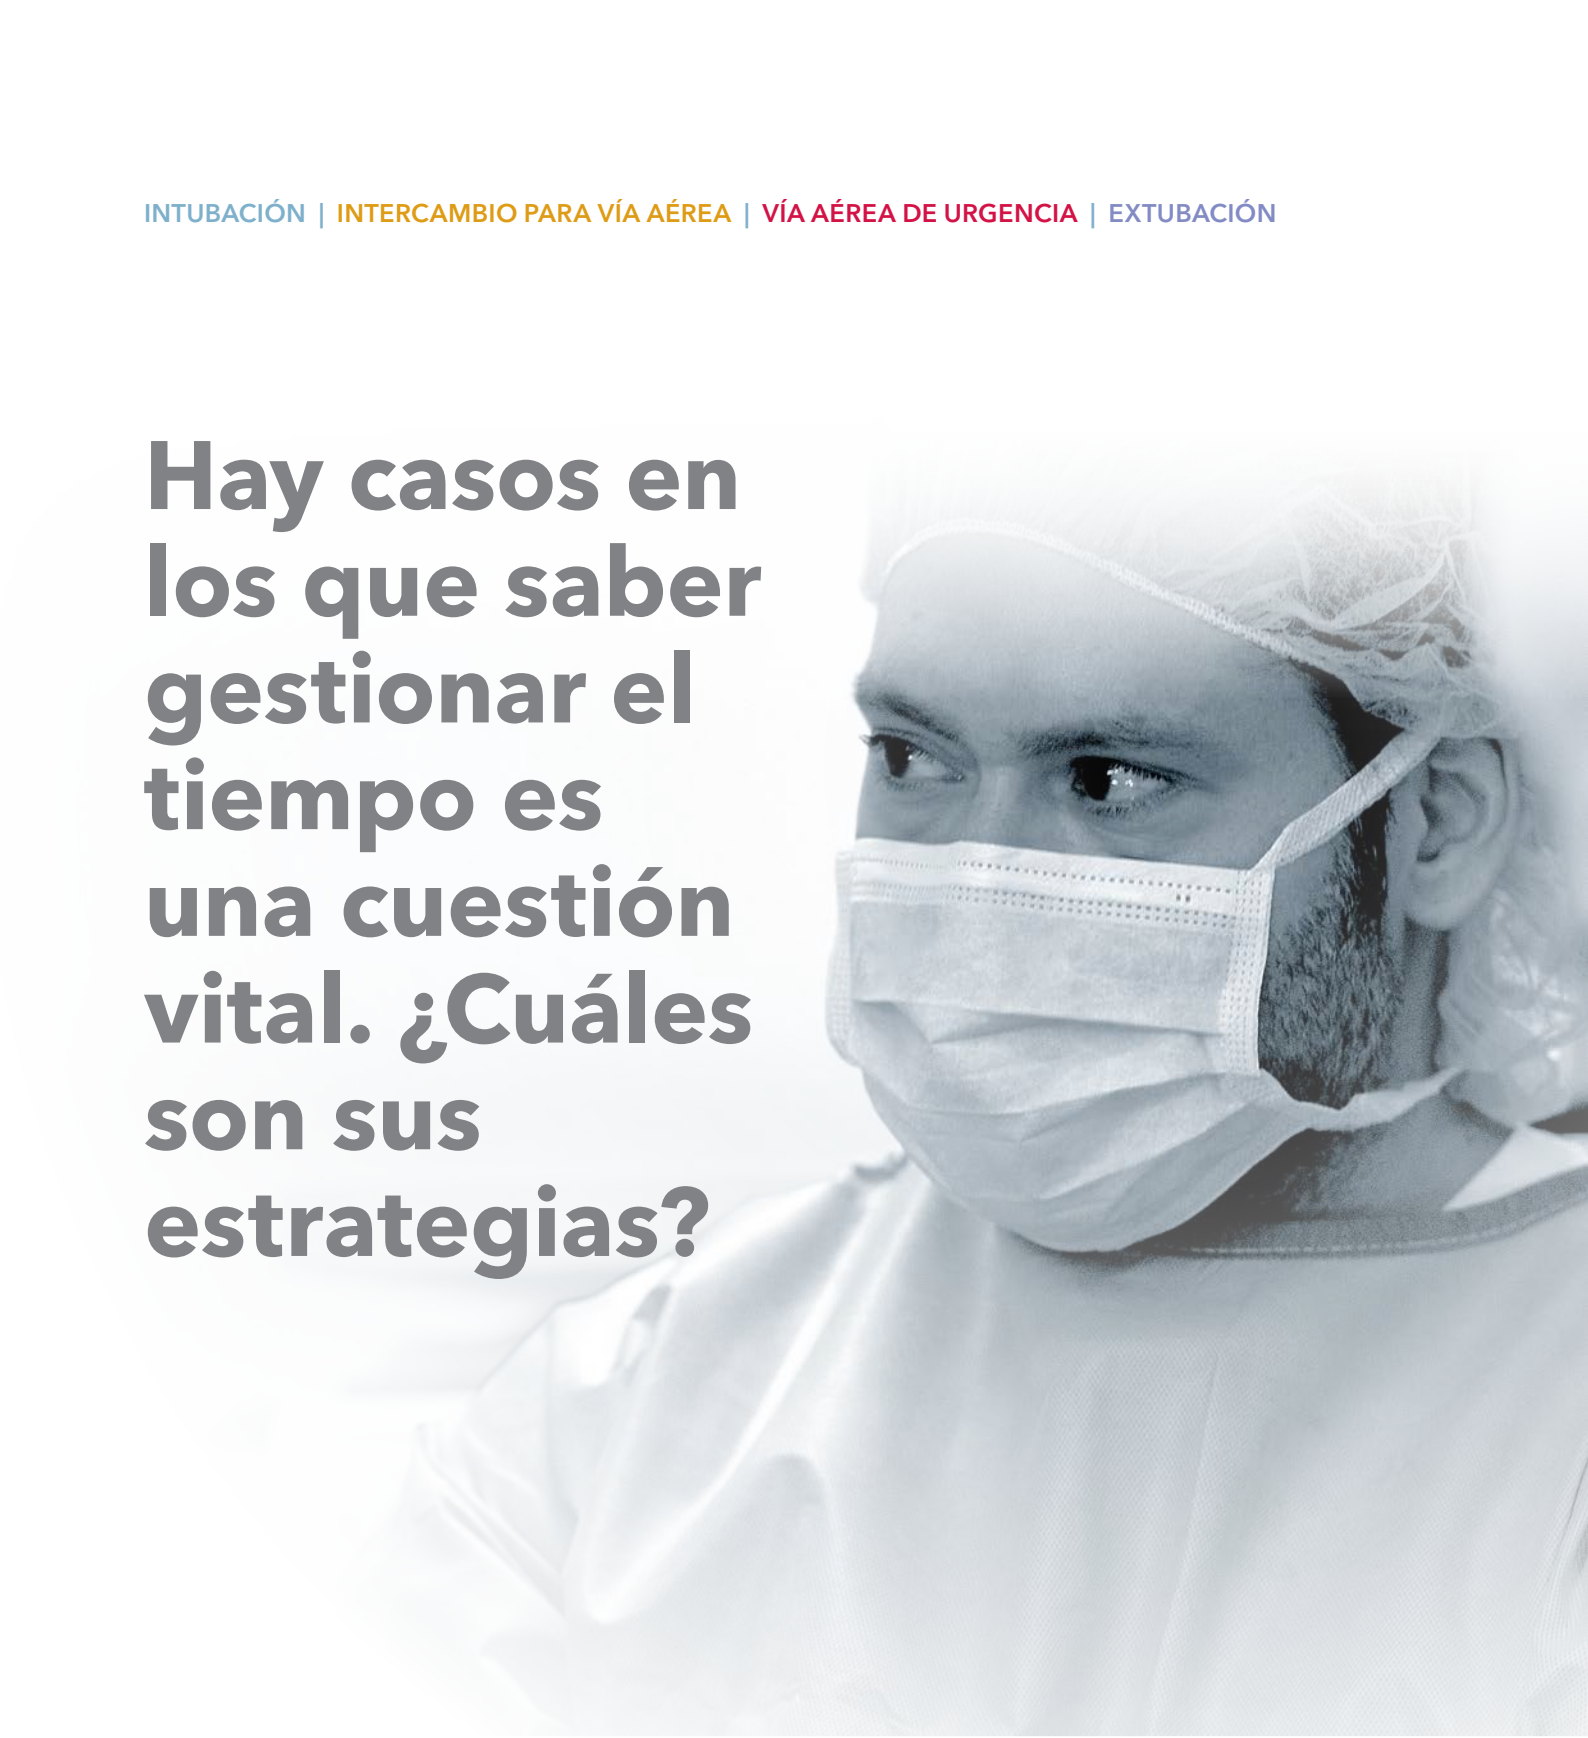

PRODUCTS FOR THE DIFFICULT AIRWAY

COOK MEDICAL

cookairway.eu

Establecer y mantener una vía aérea.

Hemos diseñado nuestros productos de gestión de las vías aéreas para ayudarle a realizar satisfactoriamente intubaciones, intercambios para vías aéreas, accesos de urgencia a la vía aérea y extubaciones.

Visite **cookairway.eu** para ver vídeos de procedimientos, obtener información adicional, o para ponerse en contacto con su representante de ventas local para solicitar una demostración del producto.

Índice

Intubación

Introductor para intubación Frova 7
Equipo de intubación retrógrada Cook® 9
Catéter de intubación Aintree 11

Intercambio para vía aérea

Catéter de intercambio para vía aérea Cook®: extrafirme con punta blanda 15
Catéter de intercambio para vía aérea Cook® 16
Equipo de catéter de intercambio para vía aérea Arndt 17

Vía aérea de urgencia

Equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker universal con balón: Seldinger/quirúrgica 21
Equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón: quirúrgica 22
Equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón: Seldinger 23
Equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker: Seldinger 24
Equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker para operaciones especiales: Seldinger 25
Equipo de modulador de flujo de oxígeno Enk 26
Catéter transtraqueal de urgencia para la vía aérea 27

Extubación

Equipo de extubación por etapas Cook 30

Recursos para vías aéreas difíciles 32

Tenemos una solución para cuando no pueda intubar, pero sí ventilar.

Intubación

Nuestros introductores para intubación permiten proporcionar oxígeno durante la intubación inicial y pueden ayudar en la colocación a ciegas, retrógrada y guiada por broncoscopia.

Introductor para intubación Frova

Para facilitar la intubación endotraqueal cuando la visualización de la glotis es insuficiente.

Detalles del producto

- El diseño romo y angulado de la punta se ha concebido para una colocación correcta del introductor pasando las cuerdas vocales y llegando a la tráquea.
- El estilete de refuerzo opcional[1] aporta rigidez a las secciones proximal y media del catéter, mientras la porción distal sigue siendo flexible.
- La luz y los orificios laterales son canales por los que se puede entregar oxígeno cuando el dispositivo se utiliza con adaptadores Rapi-Fit® y una fuente de oxígeno.
- Las marcas centimétricas del catéter facilitan la alineación precisa con los tubos endotraqueales.
- Los adaptadores Rapi-Fit extraíbles permiten la administración de oxígeno, cuando sea necesario.

Componentes

- Introductor para intubación Frova
- Estilete de refuerzo[1]
- Adaptador Rapi-Fit (conector de 15 mm)
- Adaptador Rapi-Fit (conector Luer Lock)

Referencia	Referencia de producto	Introductor Fr	Longitud del introductor cm	Para la colocación de TET[2] con D. I. mm	Incluye adaptador de tipo	Cantidad
Con estilete de refuerzo[1]						
G12591	**C-CAE-8.0-35-FII**	8	35	3 o mayor	15 mm y Luer Lock	1
G23646	**C-CAE-14.0-70-FII**	14	70	6 o mayor	15 mm y Luer Lock	1
Sin estilete de refuerzo[1]						
G23645	**C-CAE-14.0-70-FI**	14	70	6 o mayor	15 mm y Luer Lock	1
Solo introductor						
G48303	**C-CAE-14.0-70-FIC**	14	70	6 o mayor	No incluido	10
G53517	**C-CAE-14.0-70-FIC-SPOPS[3]**	14	70	6 o mayor	No incluido	1

1. También puede denominarse "cánula".
2. No se incluye el tubo endotraqueal.
3. Embalado en forma de U para mayor portabilidad y facilidad de transporte.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Adaptador Rapi-Fit®

Nuestros adaptadores Rapi-Fit extraíbles se pueden usar con conectores de 15 mm o Luer Lock. Los adaptadores permiten que los catéteres para la vía aérea se puedan conectar a un dispositivo de ventilación a fin de proporcionar oxigenación durante procedimientos de intubación o intercambio, cuando sea necesario.

Con cada producto de intubación e intercambio para vía aérea descrito viene incluido un adaptador Rapi-Fit de 15 mm y Luer Lock.

También es posible hacer pedidos del adaptador Rapi-Fit de 15 mm por separado (opción disponible únicamente para los catéteres de 14 Fr).

Imagen de un adaptador Rapi-Fit de 15 mm.

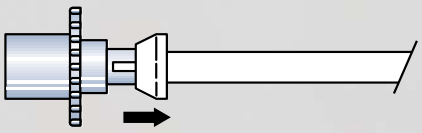

Para conectarlo
Coloque el adaptador en el catéter. Presione el anillo blanco hacia delante y bloquee el adaptador en su posición.

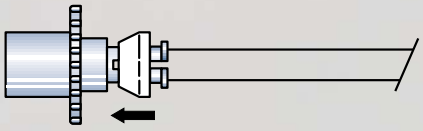

Para extraerlo
Tire hacia atrás del anillo blanco para liberarlo y luego extraiga el adaptador del catéter.

Referencia	Referencia de producto	Cantidad
G33019	C-RFA-14.0-15-CAE	1

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Equipo de intubación retrógrada Cook®

Para ayudar en la colocación de un tubo endotraqueal durante procedimientos de acceso complicado o de urgencia a la vía aérea en los que la visualización de las cuerdas vocales no sea posible por causa secundaria de secreciones, sangre o anomalías anatómicas.

Detalles del producto

- El uso de la técnica de Seldinger a través de la membrana cricotiroidea para el acceso inicial permite la colocación retrógrada (hacia la cabeza) de una guía con salida oral o nasal.
- La punta cónica del catéter radiopaco permite un desplazamiento más fluido por la estructura anatómica del paciente.
- La introducción anterógrada de un catéter guía hueco con orificios laterales distales y adaptadores Rapi-Fit permite la oxigenación del paciente y facilita la colocación de un tubo endotraqueal.

Componentes

- Catéter de intubación retrógrada Cook
- Aguja introductora de catéter
- Aguja para acceso percutáneo de una pieza
- Jeringa de 6 mL
- Guía de doble punta flexible recta y curva con marcas de posición
- Hemostato dentado desechable
- Adaptador Rapi-Fit (conector de 15 mm)
- Adaptador Rapi-Fit (conector Luer Lock)

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	Diámetro de la guía inch/mm	Longitud de la guía cm	Para la colocación de TET* con D. I. mm	Incluye adaptador de tipo	Cantidad
G09727	**C-RETRO-6.0-50-38J-110**	6	50	0,038/0,97	110	2,5 o mayor	No incluido	1
G07647	**C-RETRO-11.0-70-38J-110**	11	70	0,038/0,97	110	4 o mayor	No incluido	1
G10554	**C-RETRO-14.0-70-38J-110-CAE**	14	70	0,038/0,97	110	5 o mayor	15 mm y Luer Lock	1

*Tubo endotraqueal no incluido.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Catéter de intubación Aintree

Diseñado para la intubación asistida con fibra óptica y para el intercambio fácil y atraumático de tubos endotraqueales.

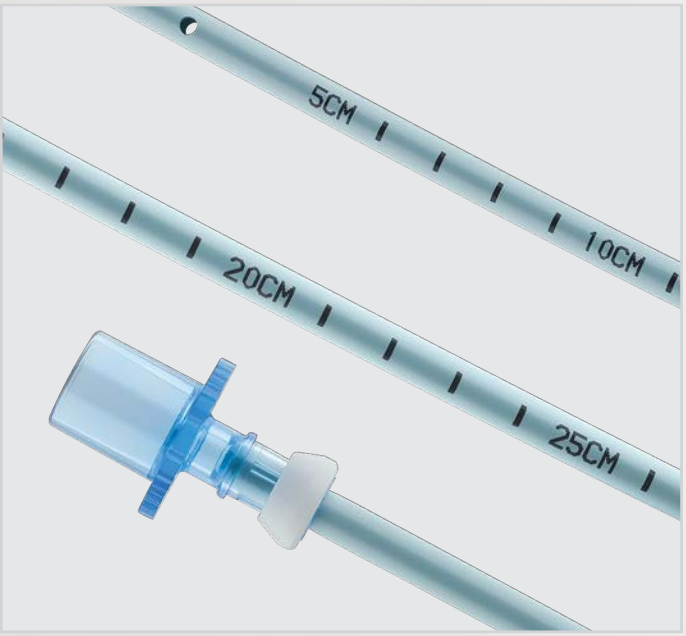

Detalles del producto

- El diámetro interno (D. I.) del catéter, la luz y los orificios laterales distales están diseñados para mejorar el flujo de aire.
- El D. I. grande permite utilizar un endoscopio de fibra óptica con un diámetro exterior máximo de 4,2 mm.
- Las marcas centimétricas facilitan la alineación precisa con los tubos endotraqueales.
- Los adaptadores Rapi-Fit extraíbles permiten la administración de oxígeno, cuando sea necesario.

Componentes

- Catéter de intubación Aintree
- Acceso broncoscópico
- Adaptador Rapi-Fit (conector de 15 mm)
- Adaptador Rapi-Fit (conector Luer Lock)

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	Para la colocación de TET* con D. I. mm	Incluye adaptador de tipo	Cantidad
G10789	**C-CAE-19.0-56-AIC**	19	56	4,7	7 o mayor	15 mm y Luer Lock	1

*Tubo endotraqueal no incluido.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Podemos ayudarle a conseguir que el proceso de intercambio sea sencillo y no cause daños.

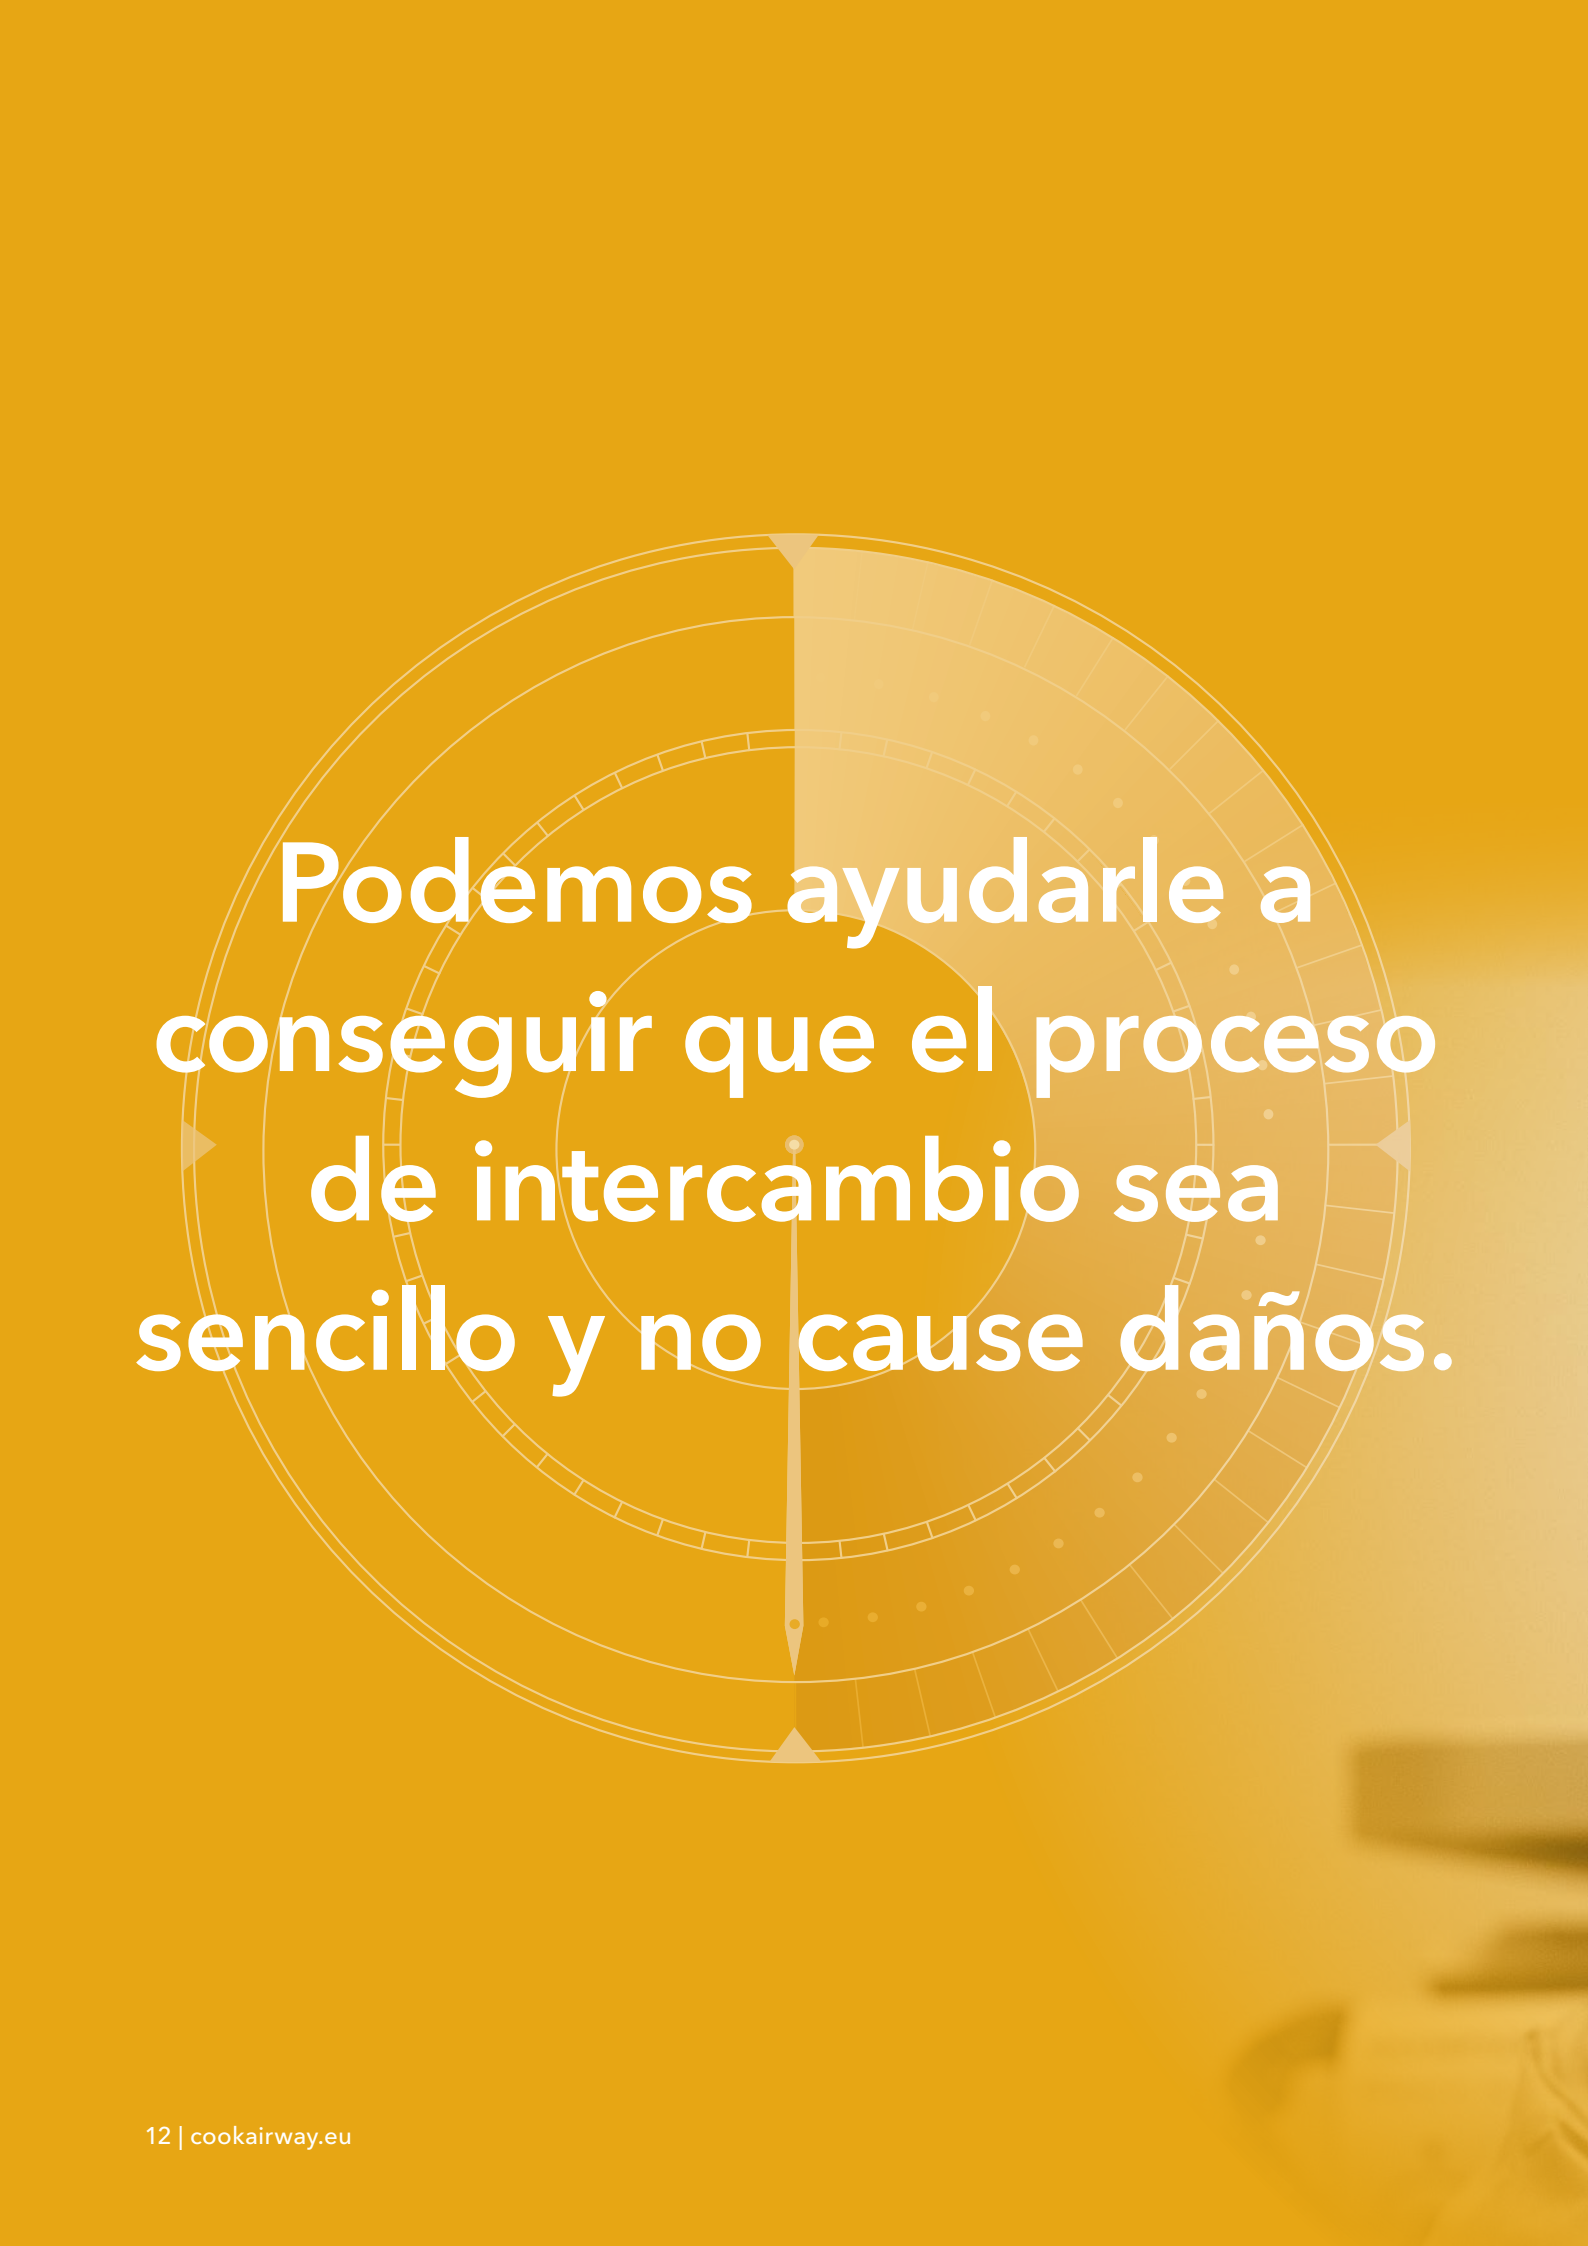

Intercambio para vía aérea

Nuestros catéteres radiopacos para intercambio están disponibles en una amplia gama de tamaños y son huecos para poder administrar oxígeno durante el intercambio. Al mantener el acceso continuo a la vía aérea, nuestros productos pueden reducir la posibilidad de que se produzcan resultados adversos en los pacientes debido a la falta de oxígeno.

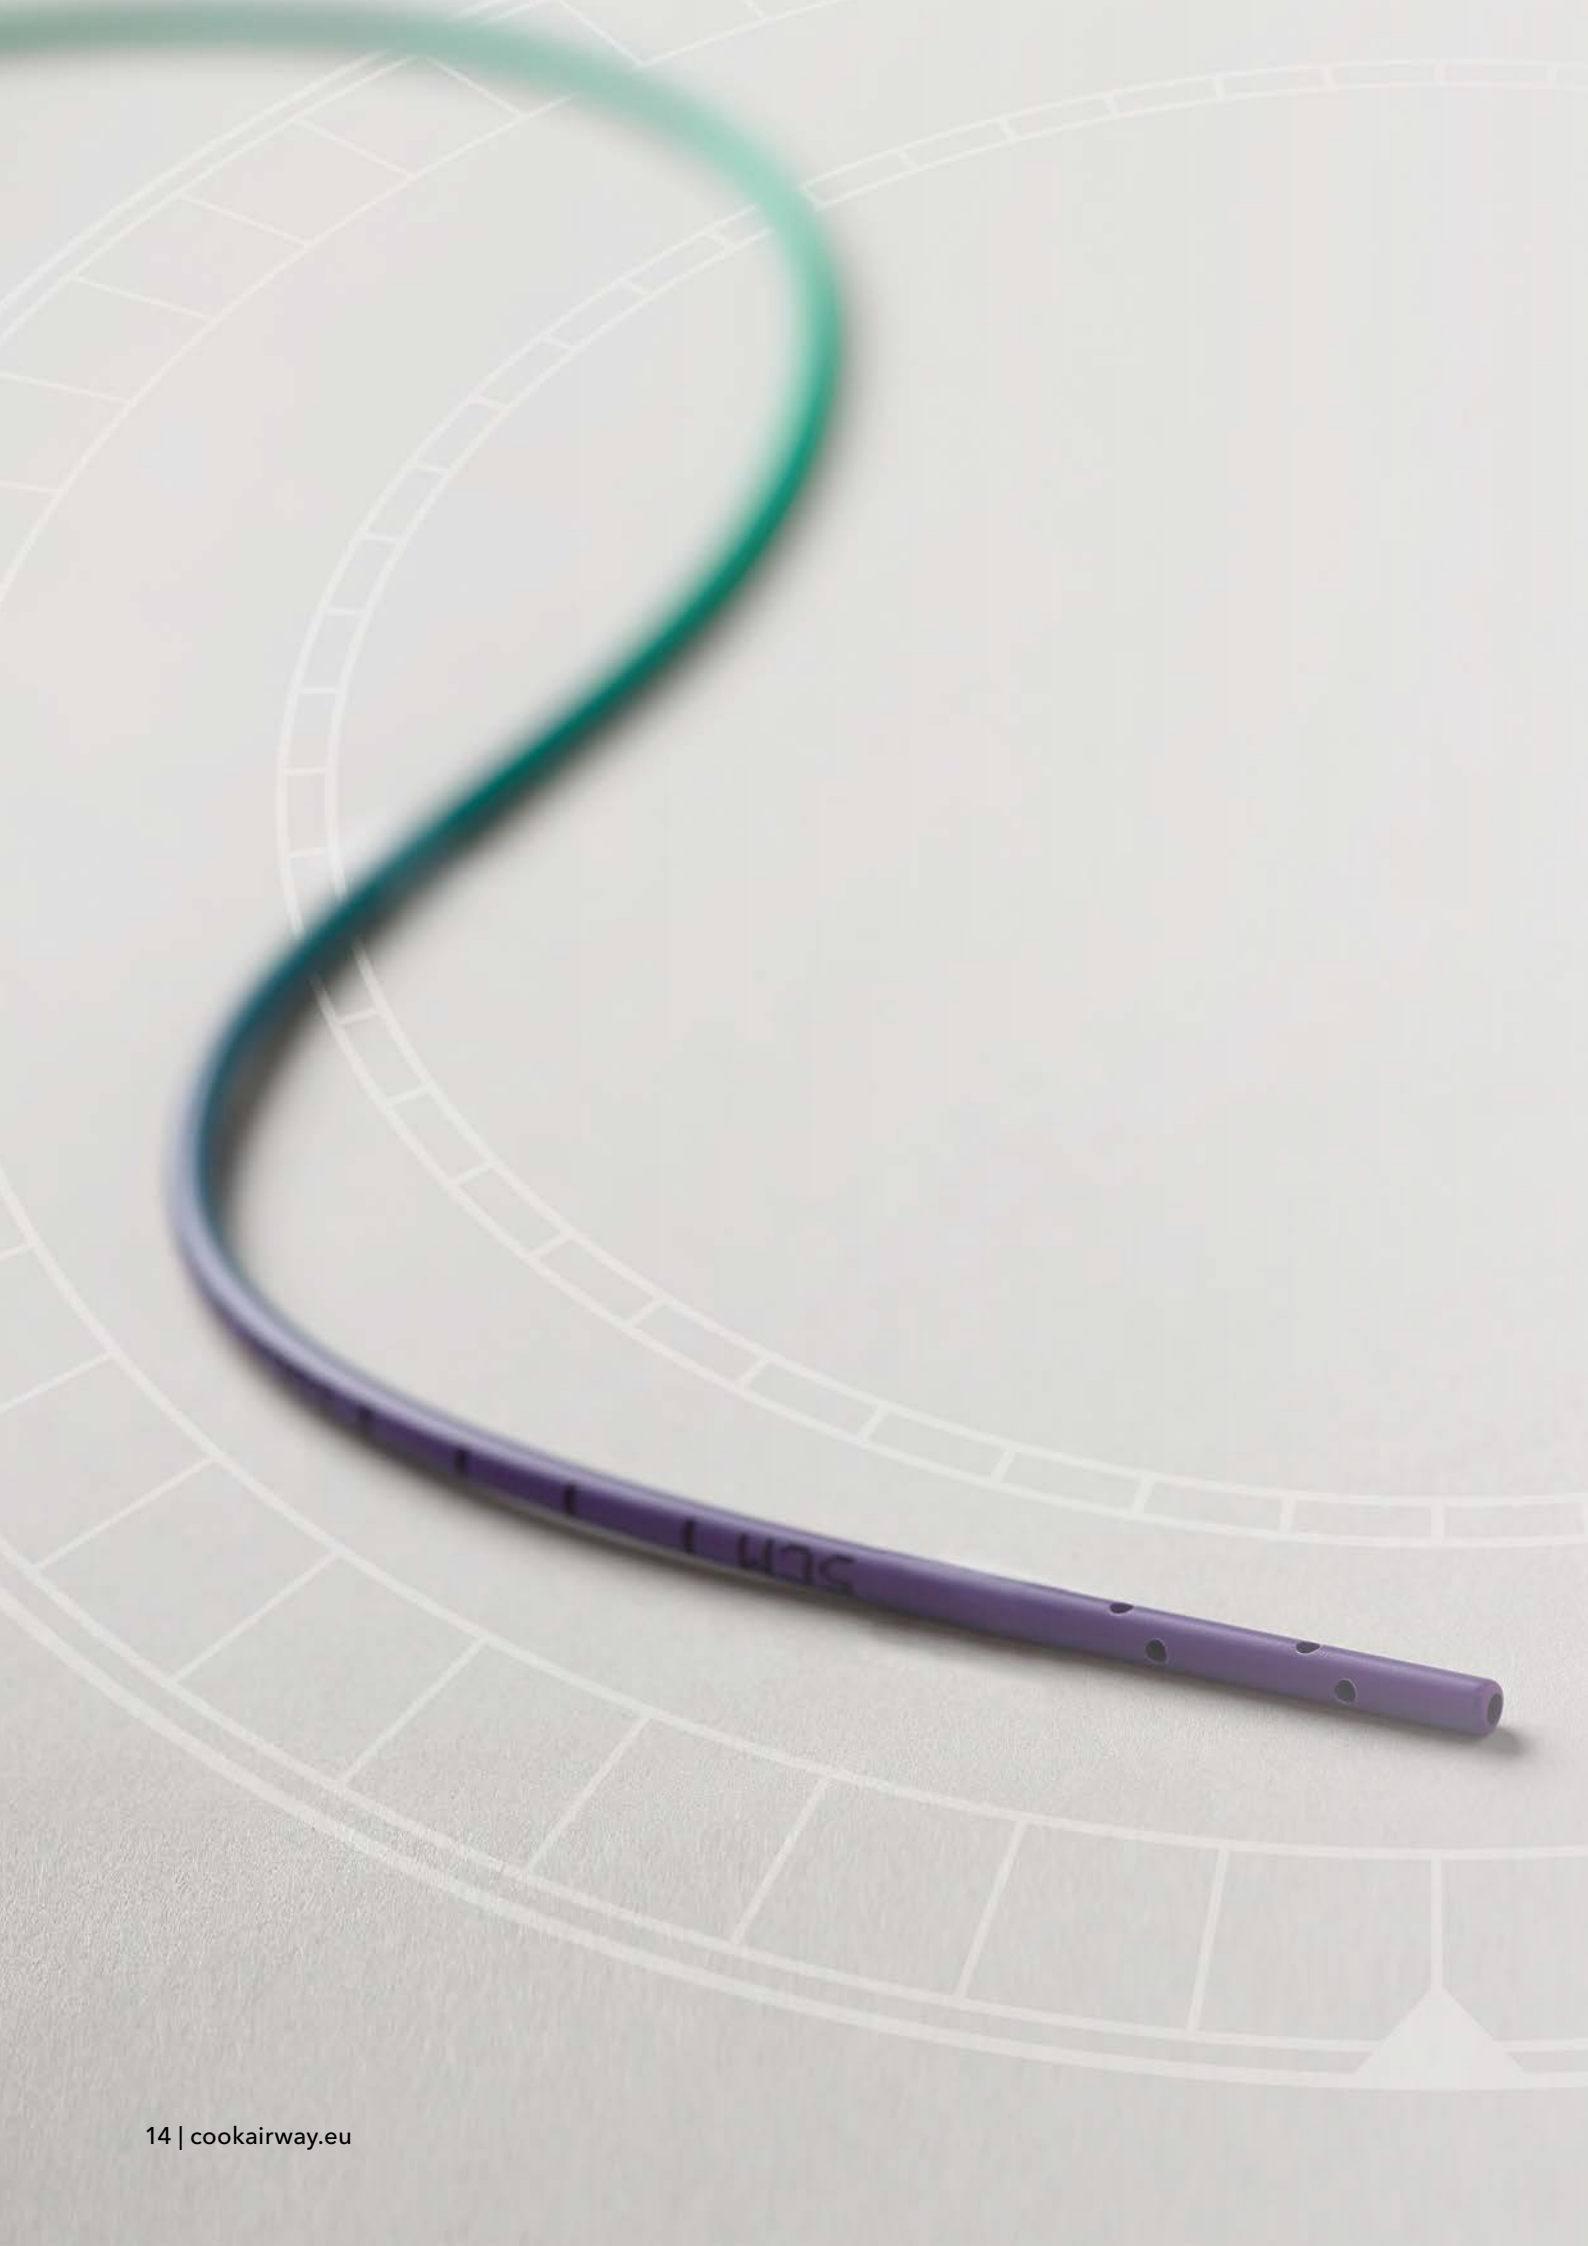

Catéter de intercambio para vía aérea Cook® extrafirme con punta blanda

Diseñado para llevar a cabo el cambio de los tubos endotraqueales de forma sencilla y sin causar ningún año.

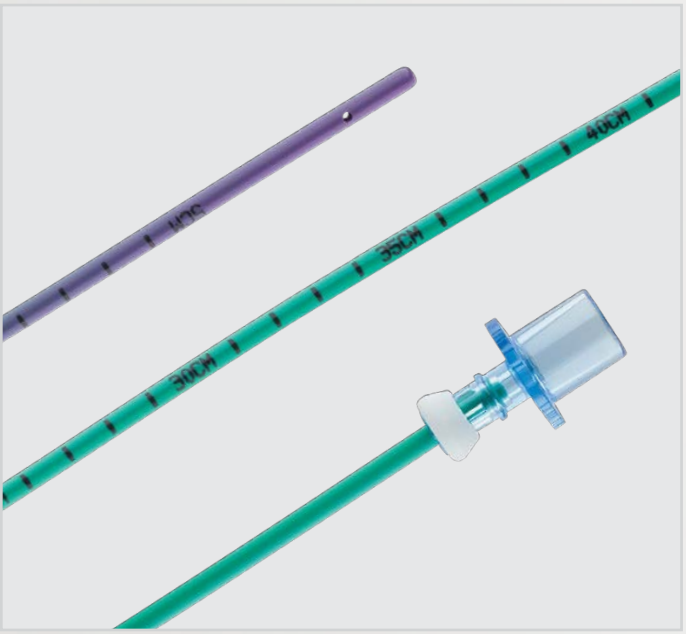

Detalles del producto

- La punta roma, blanda y flexible del catéter está diseñada para evitar que se dañen las estructuras internas.
- La sección distal del catéter es flexible.
- El catéter es extrafirme y facilita el intercambio de tubos de cuerpo de doble luz.
- La luz y los orificios laterales están diseñados para proporcionar oxígeno.
- El marcado centimétrico facilita la alineación precisa con los tubos endotraqueales.
- Los adaptadores Rapi-Fit extraíbles permiten la administración de oxígeno durante un procedimiento de intercambio, cuando sea necesario.

Componentes

- Catéter de intercambio para vía aérea Cook extrafirme con punta blanda
- Adaptador Rapi-Fit (conector de 15 mm)
- Adaptador Rapi-Fit (conector Luer Lock)

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	Para el intercambio de TET* con D. I. mm	Incluye adaptador de tipo	Cantidad
G36401	**C-CAE-11.0-100-DLT-EF-ST**	11	100	2,3	4 o mayor	15 mm y Luer Lock	1
G36402	**C-CAE-14.0-100-DLT-EF-ST**	14	100	3	5 o mayor	15 mm y Luer Lock	1

*Tubo endotraqueal no incluido.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Catéter de intercambio para vía aérea Cook®

Diseñado para llevar a cabo el cambio de los tubos endotraqueales de forma sencilla y sin causar ningún daño.

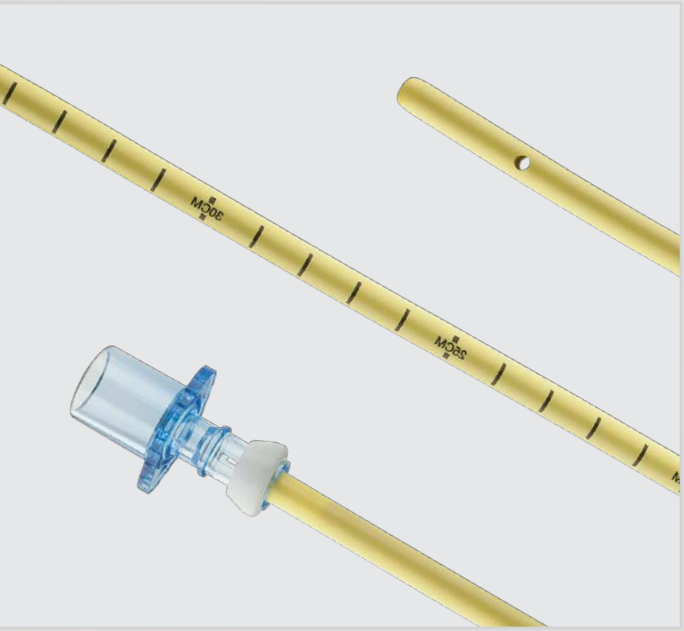

Detalles del producto

- La punta roma del catéter radiopaco evita que se dañen las estructuras internas.
- La luz y los orificios laterales están diseñados para proporcionar oxígeno.
- El marcado centimétrico facilita la alineación precisa con los tubos endotraqueales.
- Los adaptadores Rapi-Fit extraíbles permiten la administración de oxígeno durante un procedimiento de intercambio, cuando sea necesario.

Componentes

- Catéter de intercambio para vía aérea Cook
- Adaptador Rapi-Fit (conector de 15 mm)
- Adaptador Rapi-Fit (conector Luer Lock)

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	Para el intercambio de TET* con D. I. mm	Incluye adaptador de tipo	Cantidad
G07833	**C-CAE-8.0-45**	8	45	1,6	3 o mayor	15 mm y Luer Lock	1
G06732	**C-CAE-11.0-83**	11	83	2,3	4 o mayor	15 mm y Luer Lock	1
G07873	**C-CAE-14.0-83**	14	83	3	5 o mayor	15 mm y Luer Lock	1
G05880	**C-CAE-19.0-83**	19	83	3,4	7 o mayor	15 mm y Luer Lock	1

*Tubo endotraqueal no incluido.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Equipo de catéter de intercambio para vía aérea Arndt

Diseñado para el intercambio de mascarillas laríngeas de las vías aéreas y tubos endotraqueales con un broncoscopio de fibra óptica, acceso broncoscópico, una guía y un catéter de intercambio.

Detalles del producto

- El equipo puede utilizarse para la gestión electiva y de urgencia de la vía aérea.
- El uso de un broncoscopio aumenta la visualización para facilitar un desplazamiento más claro por la estructura anatómica del paciente.
- La guía con marcas de posición se puede introducir a través del orificio de trabajo del broncoscopio, lo que permite maniobrar en ángulos agudos.
- Los orificios laterales distales facilitan el flujo de aire.
- Los adaptadores Rapi-Fit extraíbles permiten el uso de una fuente de oxígeno durante un procedimiento de intercambio, cuando sea necesario.

Componentes

- Catéter de intercambio para vía aérea Arndt
- Guía extrarrígida Amplatz
- Acceso broncoscópico
- Adaptador Rapi-Fit (conector de 15 mm)
- Adaptador Rapi-Fit (conector Luer Lock)

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	Diámetro de la guía inch/mm	Guía Longitud cm	Para el intercambio de TET* con D. I. mm	Incluye adaptador de tipo	Cantidad
G11920	**C-CAE-14.0-70-LMA**	14	70	0,038/0,97	160	5 o mayor	15 mm y Luer Lock	1

*Tubo endotraqueal no incluido.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

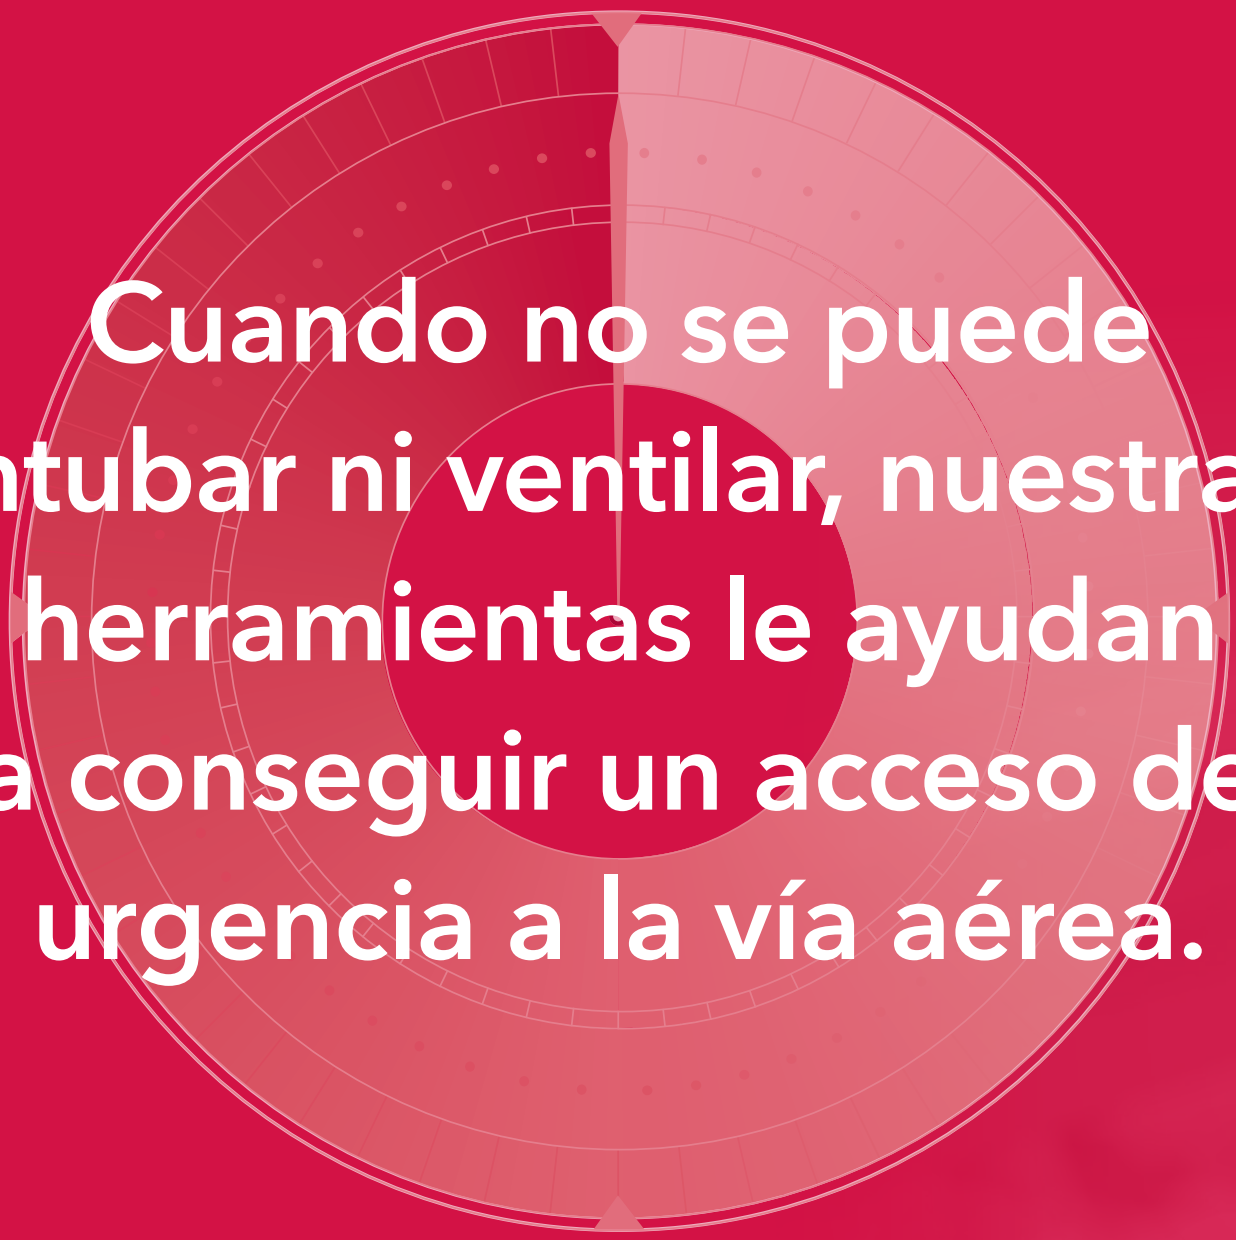

Cuando no se puede intubar ni ventilar, nuestras herramientas le ayudan a conseguir un acceso de urgencia a la vía aérea.

Vía aérea de urgencia

Ofrecemos diversos equipos de cricotirotomía de urgencia para su uso con la técnica quirúrgica o de Seldinger. Algunos de nuestros equipos incluyen un catéter con balón para vía aérea y ofrecemos productos para ventilación con catéter transtraqueal de urgencia para la vía aérea.

Equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón

Seldinger/quirúrgica

Para establecer un acceso de urgencia a la vía aérea cuando no pueda llevarse a cabo la intubación endotraqueal. El acceso a la vía aérea se consigue utilizando una técnica de entrada percutánea (de Seldinger) o una técnica quirúrgica a través de la membrana cricotiroidea.

Detalles del producto

- El equipo universal proporciona en un solo envase todos los componentes necesarios para realizar una cricotirotomía con la técnica de Seldinger o la técnica quirúrgica.
- El catéter para la vía aérea tiene un balón que protege y controla la vía aérea tras la colocación del catéter.

Componentes

- Catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón
- Aguja introductora
- Aguja introductora de catéter de PTFE
- Jeringa de 12 mL
- Minibisturí del n.º 15
- Bisturí de seguridad del n.º 20
- Guía extrarrígida Amplatz
- Dilatador curvado romo (quirúrgica)
- Dilatador curvado (Seldinger)
- Dilatador Trousseau
- Gancho traqueal
- Esparadrapo para traqueostomía
- Vaso portaagujas
- Esponjas de gasa (10)
- Paño quirúrgico de 18 x 24 inch (45,7 x 60,9 cm)

Referencia	Referencia de producto	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	D. E. del catéter mm	Diámetro de la guía inch/mm	Longitud del alambre cm	Calibre G de la aguja	Longitud de la aguja cm	Cantidad
G32442	**C-TCCSB-500-UNI-CA**	9	5	7,2	0,038/0,97	40	18	7	1

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón

Quirúrgicos

Para establecer un acceso de urgencia a la vía aérea cuando no pueda llevarse a cabo la intubación endotraqueal. El acceso a la vía aérea se consigue utilizando una técnica quirúrgica a través de la membrana cricotiroidea.

Detalles del producto

- Este equipo completo proporciona en un solo envase todos los componentes necesarios para realizar una cricotirotomía con la técnica quirúrgica.
- El equipo se suministra en un envase compacto que facilita su almacenamiento.
- El catéter para la vía aérea tiene un balón que protege y controla la vía aérea tras la colocación del catéter.

Componentes

- Catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón
- Bisturí de seguridad del n.º 11
- Dilatador curvado romo
- Dilatador Trousseau
- Gancho traqueal
- Jeringa de 6 mL
- Esparadrapo para traqueostomía

Referencia	Referencia de producto	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	D. E. del catéter mm	Cantidad
G30488	**C-TCCSB-500-SUR**	9	5	7,2	1

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón

Seldinger

Para establecer un acceso de urgencia a la vía aérea cuando no pueda llevarse a cabo la intubación endotraqueal. El acceso a la vía aérea se logra mediante una técnica de acceso percutáneo (de Seldinger), a través de la membrana cricotiroidea. La dilatación posterior del lugar de entrada traqueal y del conducto permite el paso del catéter de urgencia para la vía aérea.

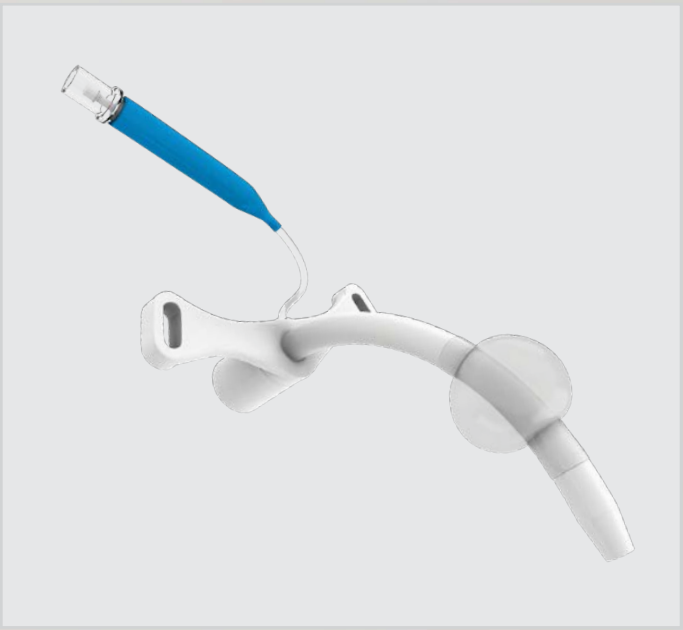

Detalles del producto

- Este equipo completo proporciona en un solo envase todos los componentes necesarios para realizar una cricotirotomía con la técnica de Seldinger.
- El catéter para la vía aérea tiene un balón que protege y controla la vía aérea tras la colocación del catéter.

Componentes

- Catéter de cricotirotomía de urgencia Melker con balón
- Aguja introductora
- Aguja introductora de catéter de PTFE
- Jeringa de 6 mL
- Minibisturí del n.º 15
- Guía extrarrígida Amplatz
- Dilatador curvado
- Esparadrapo para traqueostomía
- Vaso portaagujas

Referencia	Referencia de producto	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	D. E. del catéter mm	Diámetro de la guía inch/mm	Longitud del alambre cm	Calibre G de la aguja	Longitud de la aguja cm	Cantidad
G29432	**C-TCCSB-500**	9	5	7,2	0,038/0,97	40	18	7	1

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker

Seldinger

Para establecer un acceso de urgencia a la vía aérea cuando no pueda llevarse a cabo la intubación endotraqueal. El acceso a la vía aérea se logra mediante una técnica de acceso percutáneo (de Seldinger), a través de la membrana cricotiroidea. La dilatación posterior del lugar de entrada traqueal y del conducto permite el paso del catéter de urgencia para la vía aérea.

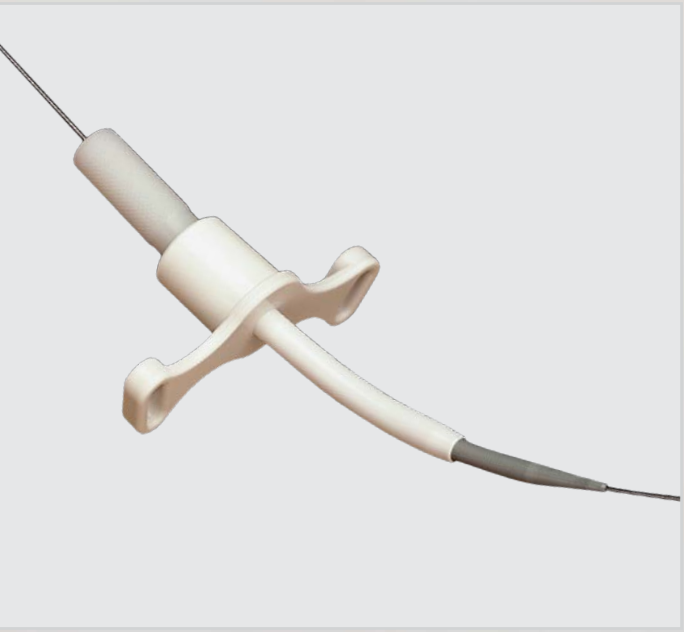

Detalles del producto

- Este equipo completo proporciona en un solo envase todos los componentes necesarios para realizar una cricotirotomía con la técnica de Seldinger.
- El catéter para la vía aérea sin balón está disponible en tres tamaños.

Componentes

- Catéter de cricotirotomía de urgencia Melker
- Aguja introductora
- Aguja introductora de catéter de PTFE
- Jeringa de 6 mL
- Minibisturí del n.º 15
- Guía extrarrígida Amplatz
- Dilatador curvado
- Esparadrapo para traqueostomía

Referencia	Referencia de producto	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	D. E. del catéter mm	Diámetro de la guía inch/mm	Longitud del alambre cm	Calibre G de la aguja	Longitud de la aguja cm	Cantidad
G06245	**C-TCCS-350**	3,8	3,5	5,1	0,038/0,97	30	18	4	1
G06246	**C-TCCS-400**	4,2	4	5,9	0,038/0,97	30	18	4	1
G04652	**C-TCCS-600**	7,5	6	8,8	0,038/0,97	40	18	7	1

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Equipo de catéter de cricotirotomía para operaciones especiales de urgencia Melker

Seldinger

Para establecer un acceso de urgencia a la vía aérea cuando no pueda llevarse a cabo la intubación endotraqueal. El acceso a la vía aérea se logra mediante una técnica de acceso percutáneo (de Seldinger), a través de la membrana cricotiroidea. La dilatación posterior del lugar de entrada traqueal y del conducto permite el paso del catéter de urgencia para la vía aérea.

Detalles del producto

- Este equipo completo proporciona en un solo envase todos los componentes necesarios para realizar una cricotirotomía con la técnica de Seldinger.
- Cada equipo se entrega en una bolsa pelable deslizante para transportarlo con más facilidad.
- Los dilatadores están ya insertados en los catéteres para la vía aérea a fin de proporcionar un acceso rápido.
- Cada equipo incluye dos agujas introductoras, de 5 y 7 cm de longitud, para abordar diferentes anatomías de los pacientes.
- El equipo con el catéter con balón está diseñado para proteger y controlar la vía aérea tras la colocación del catéter.
- El equipo con el catéter sin balón se ofrece con dos opciones de tamaño de catéteres para la vía aérea.

Componentes

- Catéter de cricotirotomía de urgencia Melker
- Dos agujas introductoras de calibre 18 G de 5 y 7 cm de longitud
- Jeringa de 6 mL
- Minibisturí del n.º 15
- Guía extrarrígida Amplatz
- Dilatador curvado
- Esparadrapo para traqueostomía

Referencia	Referencia de producto	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	D. E. del catéter mm	Diámetro de la guía inch/mm	Longitud del alambre cm	Calibre G de la aguja	Longitud de la aguja cm	Cantidad
Con catéter con balón									
G26924	**C-TCCSB-500-SPOPS**	9	5	7,2	0,038/0,97	40	18	5, 7	1
Con catéter sin balón									
G10699	**C-TCCS-600-SPOPS**	4,2, 7,5	4, 6	6, 8,8	0,038/0,97	40	18	5, 7	1

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Equipo de modulador de flujo de oxígeno Enk

El modulador de flujo de oxígeno Enk permite el control manual del flujo de oxígeno y está indicado para la ventilación con catéteres transtraqueales de urgencia cuando no pueda llevarse a cabo la ventilación tradicional mediante mascarilla o tubo endotraqueal.

Detalles del producto

- El equipo ofrece a los profesionales clínicos una solución compacta para establecer una vía aérea en poco tiempo y facilitar al mismo tiempo un flujo de oxígeno controlado manualmente.
- El catéter de alambre reforzado está diseñado para que no se produzcan acodamientos.
- El modulador de flujo de oxígeno Enk se conecta al catéter FEP reforzado transtraqueal de urgencia para la vía aérea y a una fuente de oxígeno para facilitar la entrega de oxígeno.

Componentes

- Modulador de flujo de oxígeno Enk
- Catéter FEP reforzado con aguja introductora
- Tubo conector de vinilo
- Jeringa de 5 mL

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	Calibre G de la aguja del catéter	Longitud del tubo conector cm	Cantidad
G12398	**C-EFMS-100**	6	7,5	2	15	210	1

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Catéter transtraqueal de urgencia para la vía aérea

Diseñado para el acceso de urgencia a la vía aérea cuando no puede realizarse la intubación endotraqueal convencional.

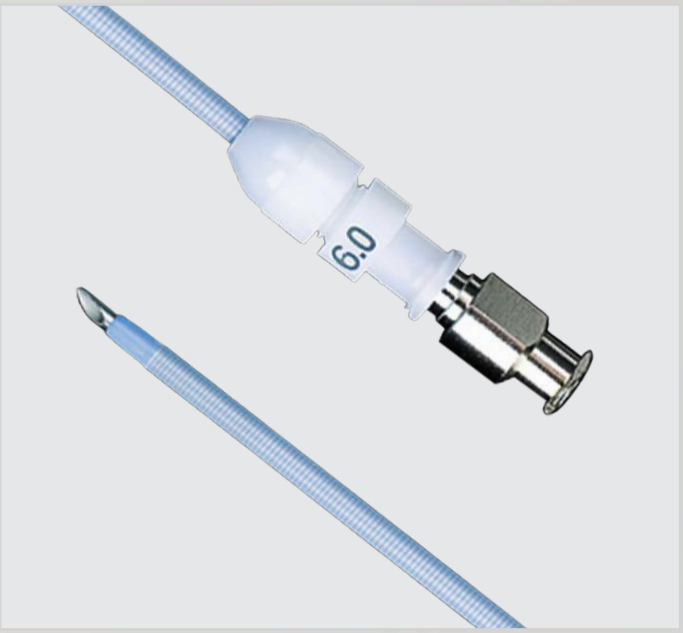

Detalles del producto

- El catéter de alambre reforzado está diseñado para que no se produzcan acodamientos.

Componentes

- Catéter FEP reforzado con aguja introductora

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	D. I. del catéter mm	Calibre G de la aguja del catéter	Cantidad
G10338	**C-DTJV-6.0-5.0-BTT**	6	5	2	15	1
G09413	**C-DTJV-6.0-7.5-BTT**	6	7,5	2	15	1

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Tenemos productos diseñados para emplear una estrategia de extubación más completa.

Extubación

Nuestro equipo incluye una guía de extubación y un catéter de reintubación para su uso en extubación por etapas. El núcleo de alambre de nitinol resistente al acodamiento proporciona una guía para el catéter de reintubación y el catéter permite la administración de oxígeno para facilitar la reintubación correcta cuando sea necesario.

Equipo de extubación por etapas Cook

Diseñado para la extubación por etapas y la reintubación posterior.

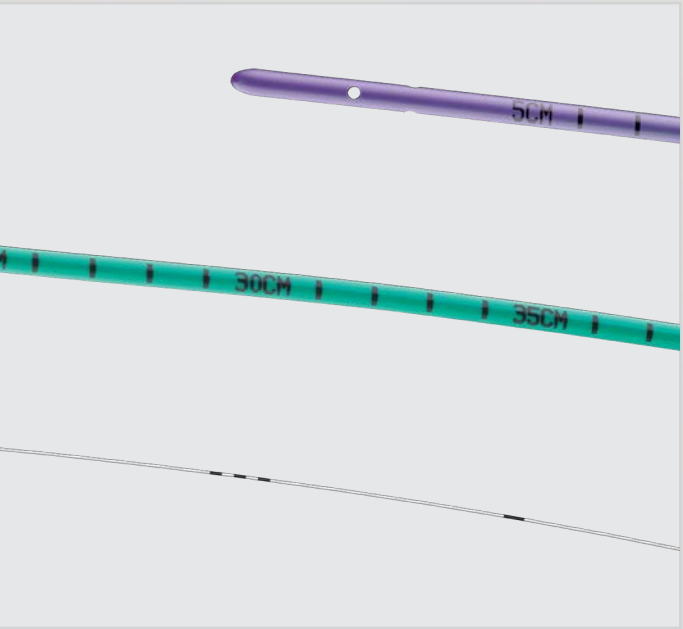

Detalles del producto

- La punta roma y blanda del catéter de reintubación está diseñada para evitar que se dañen las estructuras internas.
- La cubierta de polímero y la punta flexible de la guía de extubación por etapas garantizan una irritación mínima y una mayor comodidad para el paciente.
- El marcado centimétrico del alambre de extubación por etapas de nitinol y el catéter de reintubación por etapas facilitan la alineación precisa con el tubo endotraqueal durante los procedimientos de extubación y reintubación.
- Los orificios laterales distales del catéter de reintubación garantizan un flujo de aire suficiente y están diseñados para evitar que se produzcan sacudidas cuando se use con una fuente de oxígeno.
- Los adaptadores Rapi-Fit extraíbles permiten la administración de oxígeno, cuando sea necesario.

Componentes

- Guía de extubación por etapas
- Catéter de reintubación por etapas
- Esparadrapo de fijación
- Apósito de fijación
- Soporte para guía para vía aérea
- Adaptador Rapi-Fit (conector de 15 mm)
- Adaptador Rapi-Fit (conector Luer Lock)

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter mm	D. I. del catéter mm	Diámetro de la guía inch/mm	Longitud de la guía cm	Para la colocación de TET* con D. I. mm	Incluye adaptador de tipo	Cantidad
G24073	**C-CAE-14.0-83-EXTU**	**14**	83	3	0,035/0,88	145	≥5	15 mm y Luer Lock	5

*Tubo endotraqueal no incluido.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Catéter de reintubación por etapas

Los orificios laterales distales garantizan un flujo de aire suficiente y evitan que se produzcan sacudidas cuando se use el catéter con una fuente de oxígeno.

La punta roma y blanda está diseñada para evitar que se dañen las estructuras internas.

Guía de extubación por etapas

La cubierta de polímero de la guía de extubación garantiza una irritación mínima mientras la guía está colocada.

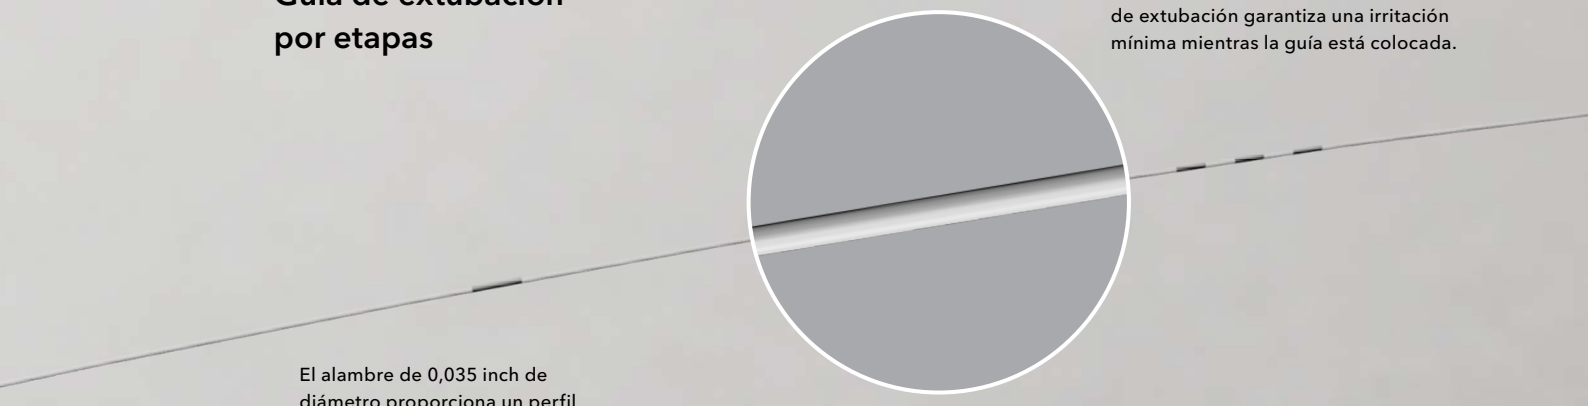

El alambre de 0,035 inch de diámetro proporciona un perfil bajo para una mayor comodidad del paciente.

Recursos para vías aéreas difíciles

Los datos sobre los recursos solo tienen fines informativos. Cook Medical no realiza ninguna afirmación acerca de la exactitud ni la integridad de cualquier información proporcionada en estos sitios.

Formación y educación

The Airway Site
theairwaysite.com

Airway On Demand
airwayondemand.com

Asociaciones

European Society of Anaesthesiology
esahq.org

Society for Airway Management
samhq.com

Difficult Airway Society
das.uk.com

American Society of Anesthesiologists
asahq.org

Australian and New Zealand College of Anaesthetists
anzca.edu.au

Australian Society of Anaesthetists
asa.org.au

Canadian Anesthesiologists' Society
cas.ca

Customer Support

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland – French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland – Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland – German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

COOK MEDICAL

`CC, URO-A4

© COOK 02/2021 CC-D58013-ES-F