


Evolution® Esophageal

CONTROLLED-RELEASE STENT

Caratteristiche




Passaggio 1

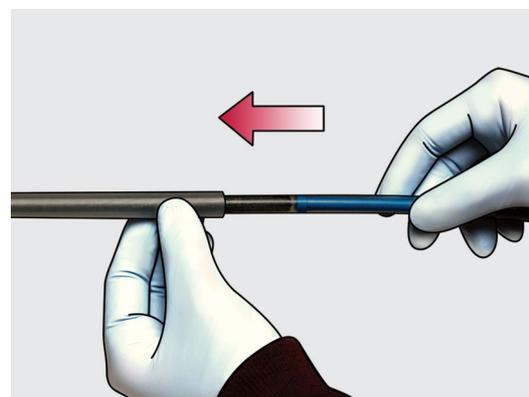

Sfilare il tubicino protettivo dallo stent.

Passaggio 2

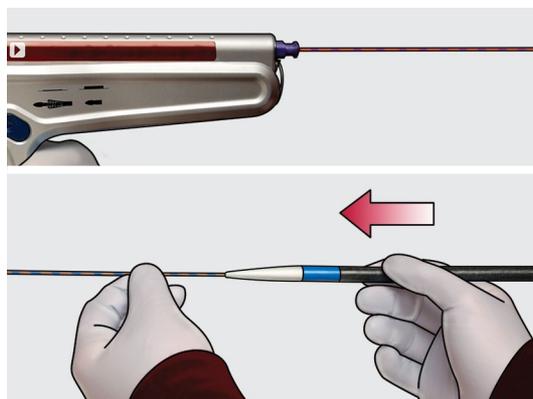


Sotto osservazione fluoroscopica, inserire e fare avanzare il sistema di introduzione in piccoli incrementi sulla guida precedentemente posizionata nell'esofago.

Passaggio 3




Posizionare sotto osservazione fluoroscopica i marker radiopachi sul catetere interno oltre le estremità della stenosi da attraversare.

Passaggio 4

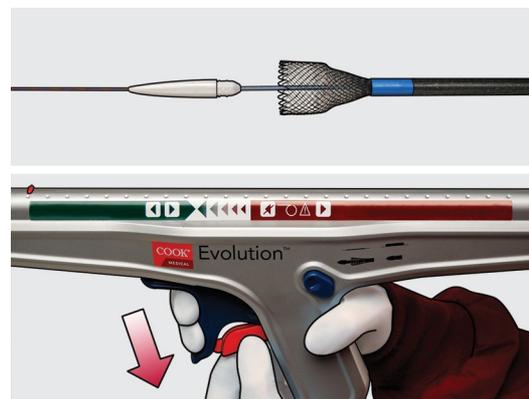


Sotto controllo fluoroscopico, confermare che lo stent si trovi nella posizione desiderata e rilasciarlo rimuovendo la protezione di sicurezza rossa dall'impugnatura. Continuare a rilasciare lo stent premendo il grilletto.

Passaggio 5a

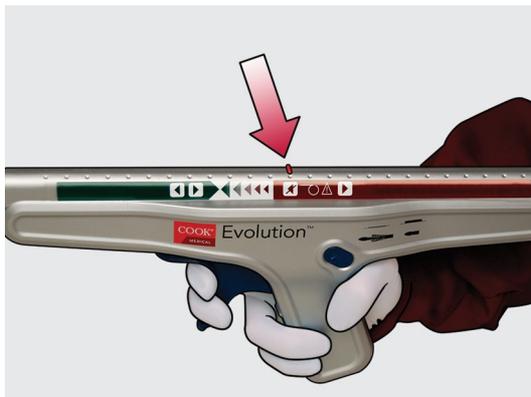


Se, durante il rilascio, è necessario riposizionare lo stent, è possibile ricatturarlo. **Nota:** non è possibile ricatturare lo stent una volta superato il punto di non ritorno, visibile quando l'indicatore di rilascio dello stent sulla parte superiore dell'introduttore ha oltrepassato l'indicatore del punto di non ritorno sull'impugnatura.

Passaggio 5b

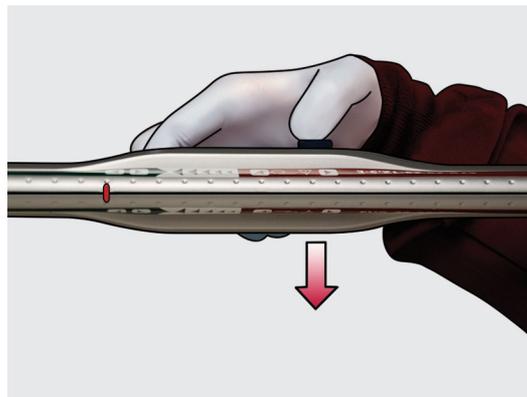

Per ricattare lo stent, premere il pulsante direzionale sul lato del sistema di inserimento verso il lato opposto. **Nota:** per ricattare lo stent, tenere premuto il pulsante con il pollice mentre si preme il grilletto per la prima volta. Continuare a premere il grilletto secondo necessità per ricattare la lunghezza desiderata dello stent.

Passaggio 6

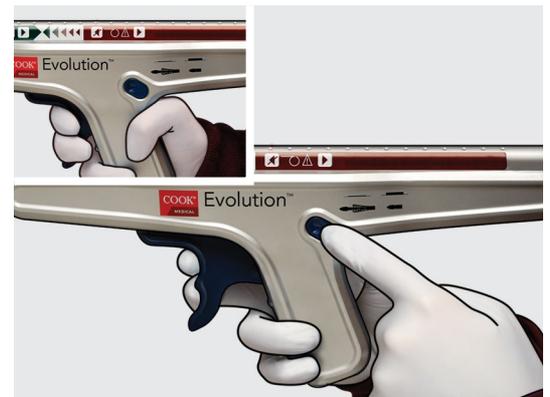


Per riprendere il rilascio, premere il pulsante direzionale nuovamente verso il lato opposto e tenere premuto il pulsante per il primo tratto quando si preme il grilletto.

Passaggio 7




Una volta superato il punto di non ritorno dello stent, sfilare la guida di sicurezza dall'impugnatura di rilascio, vicino al raccordo per la guida. Continuare a rilasciare lo stent premendo il grilletto.

Passaggio 8

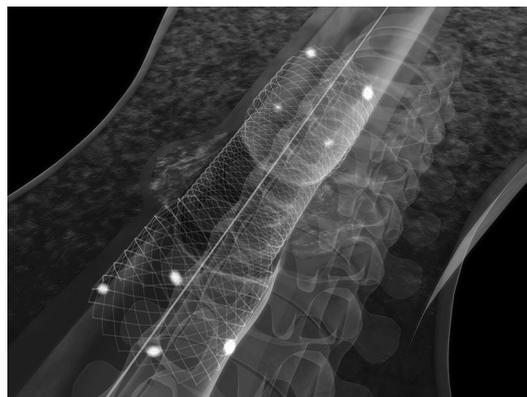

Dopo il rilascio, confermare sotto osservazione fluoroscopica che lo stent sia dilatato. Una volta confermata l'espansione, è possibile rimuovere in sicurezza il sistema di introduzione.

Passaggio 9

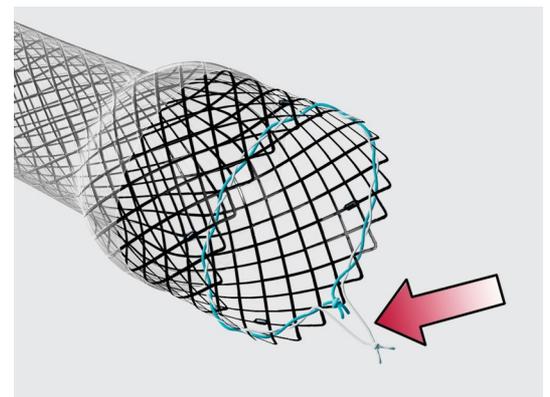

Grazie all'ansa bianca situata sull'estremità prossimale dello stent è possibile riposizionare lo stent subito dopo il posizionamento. Per riposizionare lo stent nell'area desiderata, tirare l'ansa bianca con una pinza.

Per dettagli sull'uso del sistema, consultare le istruzioni aggiornate.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, IS.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11