flexGRIP®

catheter cushion and **stabilization device**

UNIVERSAL



Die Lösung für bekannte Probleme **mit Nähten:**

- ✓ minimiert Komplikationen im Zusammenhang mit Nähten[1, 2, 3, 8]
- ✓ erhöht Patientenkomfort[5] und -sicherheit[1, 6, 7]
- ✓ verhindert Nadelstichverletzungen[1, 8]

sicher[1, 6, 7]
praktisch[5]
anwendungs-freundlich[5]
vielseitig[10]

HIGH FIXATION STRENGTH[7]
WITH
AIR PILLOW
TECHNOLOGY
NO IMPACT TO FLOW RATE[6]

Weitere Informationen unter **www.flex-grip.com**


bedal


FlexGRIP®

catheter cushion and **stabilization device**


UNIVERSAL

geeignet für die Stabilisierung und Fixierung zahlreicher Drainagekatheter [10]

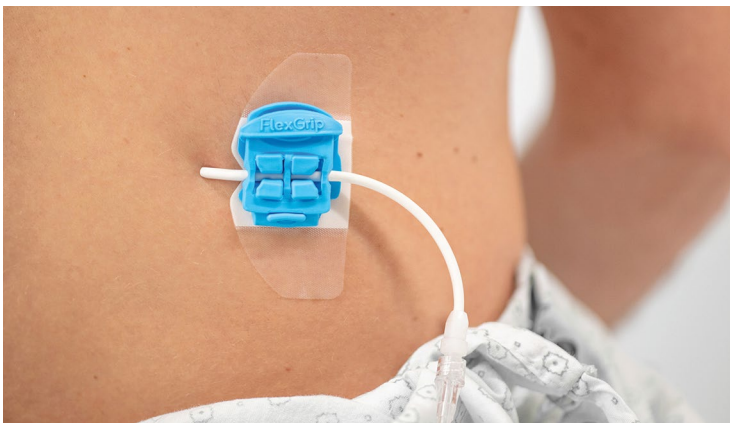

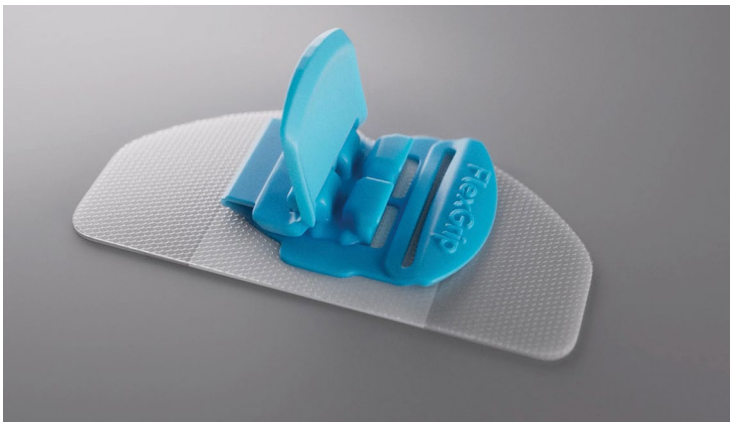

Luftkissentechnologie

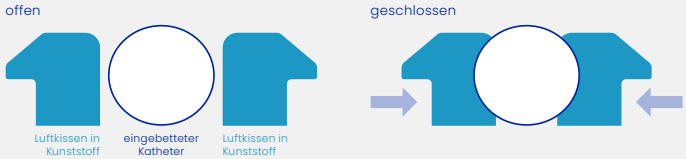

Besserer Halt[7] ohne Beeinträchtigung der Flussrate[6]

Produkte von Bedal sind steril sowie frei von Latex, PVC und DEHP.
Produkte von Bedal verfügen über die CE-Kennzeichnung sowie die FDA-Zulassung.

Merkmale

- großer Durchmesserbereich: 5–18 Fr
- unvergleichlich **starke** Fixierung[7]
- keine Beeinträchtigung der Flussrate[6]
- **anwendungsfreundlich**[5], integrierte Fixierlasche
- zusätzliche Sperre für Lasche
- **hautverträglicher**[11] hypoallergener Klebstoff
- ausschließlich **weiche**[9] Materialien

Vorteile

- Universalsystem, große Anwendungsvielfalt
- **verhindert Kathetermigration**[7] und katheterbedingte Komplikationen
- zusätzlicher **Sicherheitsrand**[1, 6, 7] verhindert versehentliches Loslösen
- **verhindert MARSI**[11] (Hautschädigungen durch klebende Verbandmittel)
- optimaler **Patientenkomfort**[5]

Bestellinformationen

Referenz-nummer	Bestell-nummer	Beschreibung und Größen	Menge
FLEXS-10	G60218	FlexGRIP Universal, Größe S, 5–11 Fr	10 St./Karton
FLEXS-50	G60219	FlexGRIP Universal, Größe 5–10 Fr	50 St./Karton
FLEXM-10	G60220	FlexGRIP Universal, Größe M, 11–18 Fr	10 St./Karton
FLEXM-50	G60221	FlexGRIP Universal, Größe 11–18 Fr	50 St./Karton

Anleitungsvideo

FLEXS, FLEXM

Flexgrip – Quellen

1. Griswold S, Bonaroti A, Rieder CJ, et al. Investigation of a safety-engineered device to prevent needlestick injury: why has not StatLock stuck? BMJ Open. 2013;3():e002327.
2. Intravascular catheter-related infection (BSI). Centers for Disease Control and Prevention Web site. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/bsi/. Aktualisiert am 5. November 2015. Abgerufen am 24. Juli 2023.
3. Petree C, Wright DL, Sanders V, et al. Reducing blood stream infections during catheter insertion. Radiol Technol. 2012;83(6):532–540.
4. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections, 2011. Centers for Disease Control and Prevention Web site. https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi-guidelines-2011.pdf. Aktualisiert im Oktober 2017. Abgerufen am 24. Juli 2023.
5. Hospital tests: hospital user testing report. 6-20220220 (2022).
6. Flow rate (time/volume) of drains when attached in fixation mechanism: flow test P8. 9-20220524 (2022).
7. Tensile strength on skin: pull test P8. 8-20220524 (2022).
8. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). OSHA Fact Sheet: Securing Medical Catheters. Washington, DC: OSHA; 2004:2.
9. Quellen bezüglich „weich". V01 (2023).
10. Quellen bezüglich „vielseitig". V01 (2023).
11. Quellen bezüglich „MARSI". V01 (2023).

bedal

Weitere Informationen unter **www.flex-grip.com**

COOK® MEDICAL

Vertrieb durch
Cook Medical LLC
400 Daniels Way
Bloomington, IN 47404, USA

© COOK 03/2026 IR-WF999650-DE-F