
flexGRIP®

catheter cushion and **stabilization device**

UNIVERSAL

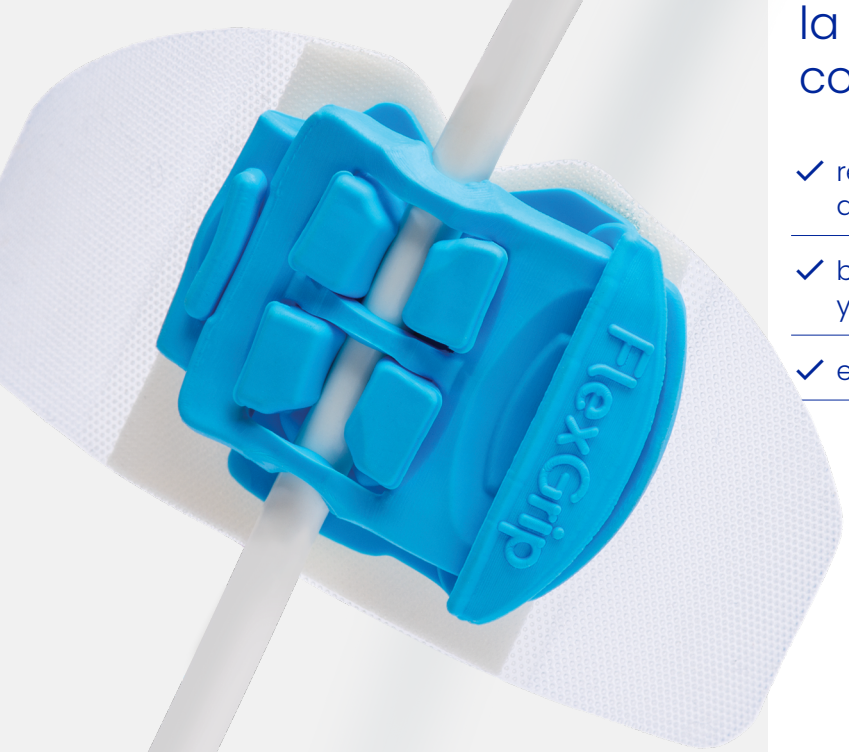

la solución a los problemas conocidos **de las suturas:**

- ✓ reduce al mínimo las complicaciones asociadas a las suturas[1, 2, 3, 8]
- ✓ brinda al paciente mayor comodidad[5] y seguridad[1, 6, 7]
- ✓ evita lesiones por pinchazos de agujas[1, 8]

seguro[1, 6, 7]
cómodo[5]
fácil de usar[5]
versátil[10]

HIGH FIXATION STRENGTH[7]
WITH
AIR PILLOW
TECHNOLOGY
NO IMPACT TO FLOW RATE[6]

Más información en **www.flex-grip.com**


bedal


FlexGRIP®

catheter cushion and **stabilization device**

UNIVERSAL

adecuado para estabilizar y fijar una gran variedad de catéteres de drenaje[10]

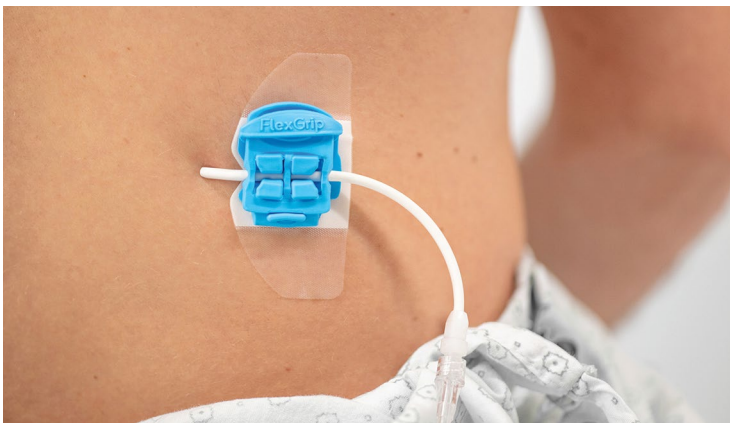

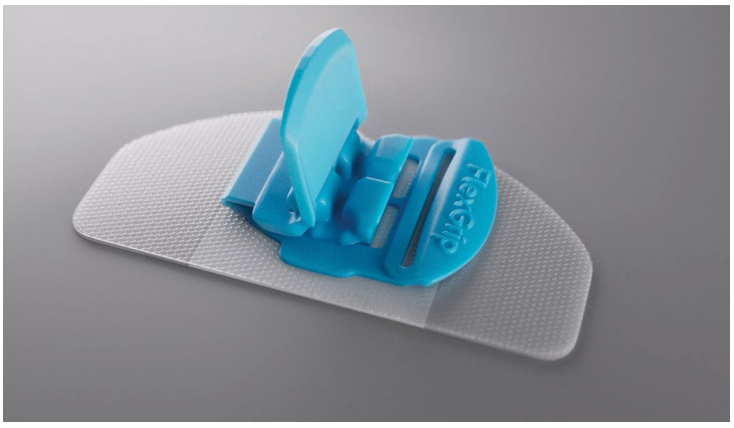

tecnología de almohadilla de aire



Agarre optimizado[7] sin impacto en el caudal[6]

Los productos de Bedal son estériles y no contienen látex, PVC ni DEHP.
Los productos de Bedal cuentan con el marcado CE y están autorizados por la FDA.

características

- amplio intervalo de diámetros: 5-18 Fr
- sujeción **firme**[7] sin precedentes
- sin impacto en el caudal[6]
- **facilidad de uso**[5]; banda de fijación premontada
- bloqueo adicional para la banda de fijación
- adhesivo hipoalergénico que **no daña la piel**[11]
- solo materiales **blandos**[9]

ventajas

- sistema universal, gran diversidad de aplicaciones
- diseñado para **evitar la migración del catéter**[7] y otras complicaciones relacionadas
- reborde de **seguridad**[1, 6, 7] extra para evitar que se afloje por accidente
- diseñado para **prevenir las lesiones cutáneas por adhesivo sanitario**[11] (MARSI, por sus siglas en inglés)
- **comodidad**[5] **inmejorable para el paciente**

información para pedidos

referencia de producto	referencia	descripción e intervalo de tamaños	cantidad
FLEXS-10	G60218	FlexGRIP Universal, tamaño S, 5-11 Fr	10 uds./caja
FLEXS-50	G60219	FlexGRIP Universal, tamaño 5-10 Fr	50 uds./caja
FLEXM-10	G60220	FlexGRIP Universal, tamaño M, 11-18 Fr	10 uds./caja
FLEXM-50	G60221	FlexGRIP Universal, tamaño 11-18 Fr	50 uds./caja

vídeo explicativo
FLEXS, FLEXM

Bibliografía sobre Flexgrip

1. Griswold S, Bonaroti A, Rieder CJ, et al. Investigation of a safety-engineered device to prevent needlestick injury: why has not StatLock stuck? BMJ Open. 2013;3():e002327.
2. Intravascular catheter-related infection (BSI). Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/bsi/. Fecha de última actualización: 5 de noviembre de 2015. Fecha de último acceso: 24 de julio de 2023.
3. Petree C, Wright DL, Sanders V, et al. Reducing blood stream infections during catheter insertion. Radiol Technol. 2012;83(6):532–540.
4. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections, 2011. Sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi-guidelines-2011.pdf. Fecha de última actualización: octubre de 2017. Fecha de último acceso: 24 de julio de 2023.
5. Pruebas en hospital: informe de pruebas en hospital al usuario. 6-20220220 (2022).
6. Flow rate (time/volume) of drains when attached in fixation mechanism: flow test P8. 9-20220524 (2022).
7. Resistencia a la tracción de la piel: prueba de tracción P8. 8-20220524 (2022).
8. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). OSHA Fact Sheet: Securing Medical Catheters. Washington, DC: OSHA; 2004:2.
9. Bibliografía relativa a la cualidad de «blando». V01 (2023).
10. Bibliografía relativa a la versatilidad. V01 (2023).
11. Bibliografía relativa a las MARSI. V01 (2023).

bedal

Más información en **www.flex-grip.com**

COOK® MEDICAL

Distribuido por
Cook Medical LLC
400 Daniels Way
Bloomington, IN 47404 (EE. UU.)

© COOK 03/2026 IR-WF999650-ES-F