flexGRIP®

catheter cushion and **stabilization device**

UNIVERSAL



La risposta a problemi noti **relativi alle suture:**

- ✓ riduce al minimo le complicanze associate alle suture[1, 2, 3, 8]
- ✓ migliora il comfort[5] e la sicurezza[1, 6, 7] del paziente
- ✓ evita le ferite da puntura di ago[1, 8]

Sicuro[1, 6, 7]
Comodo[5]
Facile da usare[5]
Versatile[10]

HIGH FIXATION STRENGTH[7]
WITH
AIR PILLOW TECHNOLOGY
NO IMPACT TO FLOW RATE[6]


Ulteriori informazioni su **www.flex-grip.com**


bedal

FlexGRIP® UNIVERSAL


catheter cushion and **stabilization device**

Ideale per stabilizzare e fissare un'ampia varietà di cateteri di drenaggio[10]

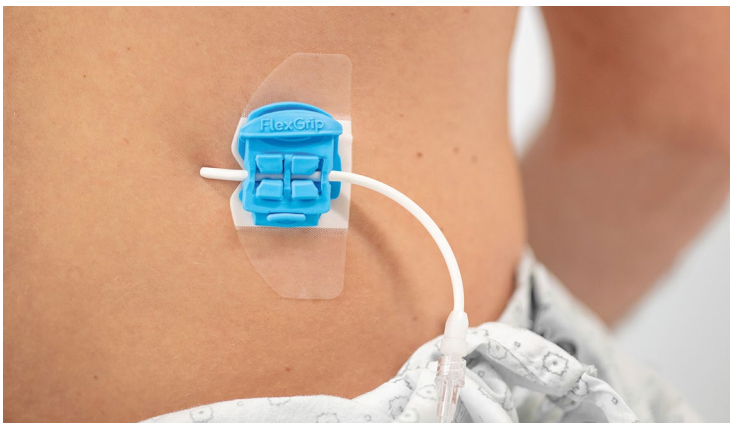

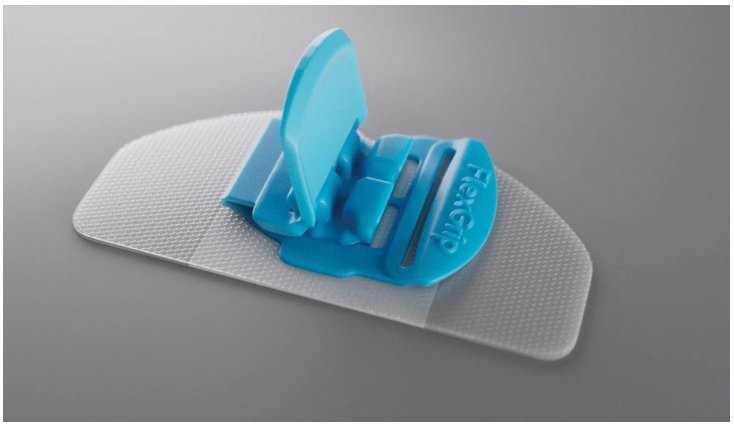

Tecnologia con cuscino ad aria

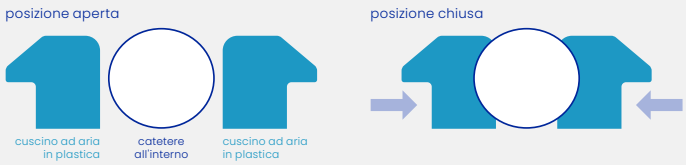

Presa migliore[7] senza impatto sulla velocità di flusso[6]

I prodotti Bedal sono sterili e privi di lattice, PVC e DEHP.
I prodotti Bedal dispongono di approvazione CE e registrazione FDA.

bedal

Ulteriori informazioni su **www.flex-grip.com**

Caratteristiche

- ampia gamma di diametri: 5-18 Fr
- **forza** di fissaggio senza pari[7]
- nessun impatto sulla velocità di flusso[6]
- nastro di fissaggio premontato, **facile da usare**[5]
- blocco aggiuntivo per il nastro
- adesivo ipoallergenico **sicuro sulla pelle**[11]
- solo materiali **morbidi**[9]

Vantaggi

- sistema universale, ampia varietà di applicazioni
- progettato per **evitare la migrazione del catetere**[7] e le relative complicanze
- l'ulteriore bordo di **sicurezza**[1, 6, 7] evita l'allentamento accidentale
- progettato per **evitare le MARSI**[11] (lesioni cutanee associate a dispositivi medici adesivi)
- comfort per il paziente **ottimale**[5]

Informazioni per l'ordine

Codice prodotto	Codice di ordinazione	Descrizione e gamma di misure	Qtà
FLEXS-10	G60218	FlexGRIP Universal, misura S, 5-11 Fr	10 PEZZI/CONF.
FLEXS-50	G60219	FlexGRIP Universal, misura 5-10 Fr	50 PEZZI/CONF.
FLEXM-10	G60220	FlexGRIP Universal, misura M, 11-18 Fr	10 PEZZI/CONF.
FLEXM-50	G60221	FlexGRIP Universal, misura 11-18 Fr	50 PEZZI/CONF.

Video di istruzioni

FLEXS, FLEXM

Riferimenti Flexgrip

1. Griswold S, Bonaroti A, Rieder CJ, et al. Investigation of a safety-engineered device to prevent needlestick injury: why has not StatLock stuck? BMJ Open. 2013;3():e002327.
2. Intravascular catheter-related infection (BSI). Sito web dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie. https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/bsi/. Aggiornamento: 5 novembre 2015. Data di consultazione: 24 luglio 2023.
3. Petree C, Wright DL, Sanders V, et al. Reducing blood stream infections during catheter insertion. Radiol Technol. 2012;83(6):532–540.
4. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections, 2011. Sito web dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie. https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi-guidelines-2011.pdf. Aggiornamento: ottobre 2017. Data di consultazione: 24 luglio 2023.
5. Test ospedalieri: report dei test sugli utilizzatori negli ospedali. 6-20220220 (2022).
6. Flow rate (time/volume) of drains when attached in fixation mechanism: flow test P8. 9-20220524 (2022).
7. Resistenza alla trazione sulla cute: test di trazione P8. 8-20220524 (2022).
8. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). OSHA Fact Sheet: Securing Medical Catheters. Washington, DC: OSHA; 2004:2.
9. Riferimenti relativi alla morbidezza. V01 (2023).
10. Riferimenti relativi alla versatilità. V01 (2023).
11. Riferimenti relativi alle MARSI. V01 (2023).

COOK® MEDICAL

Distribuito da
Cook Medical LLC
400 Daniels Way
Bloomington, IN 47404 USA

© COOK 03/2026 IR-WF999650-IT-F