


# Einfache Handhabung, zuverlässige Reparatur.<sup>1</sup>

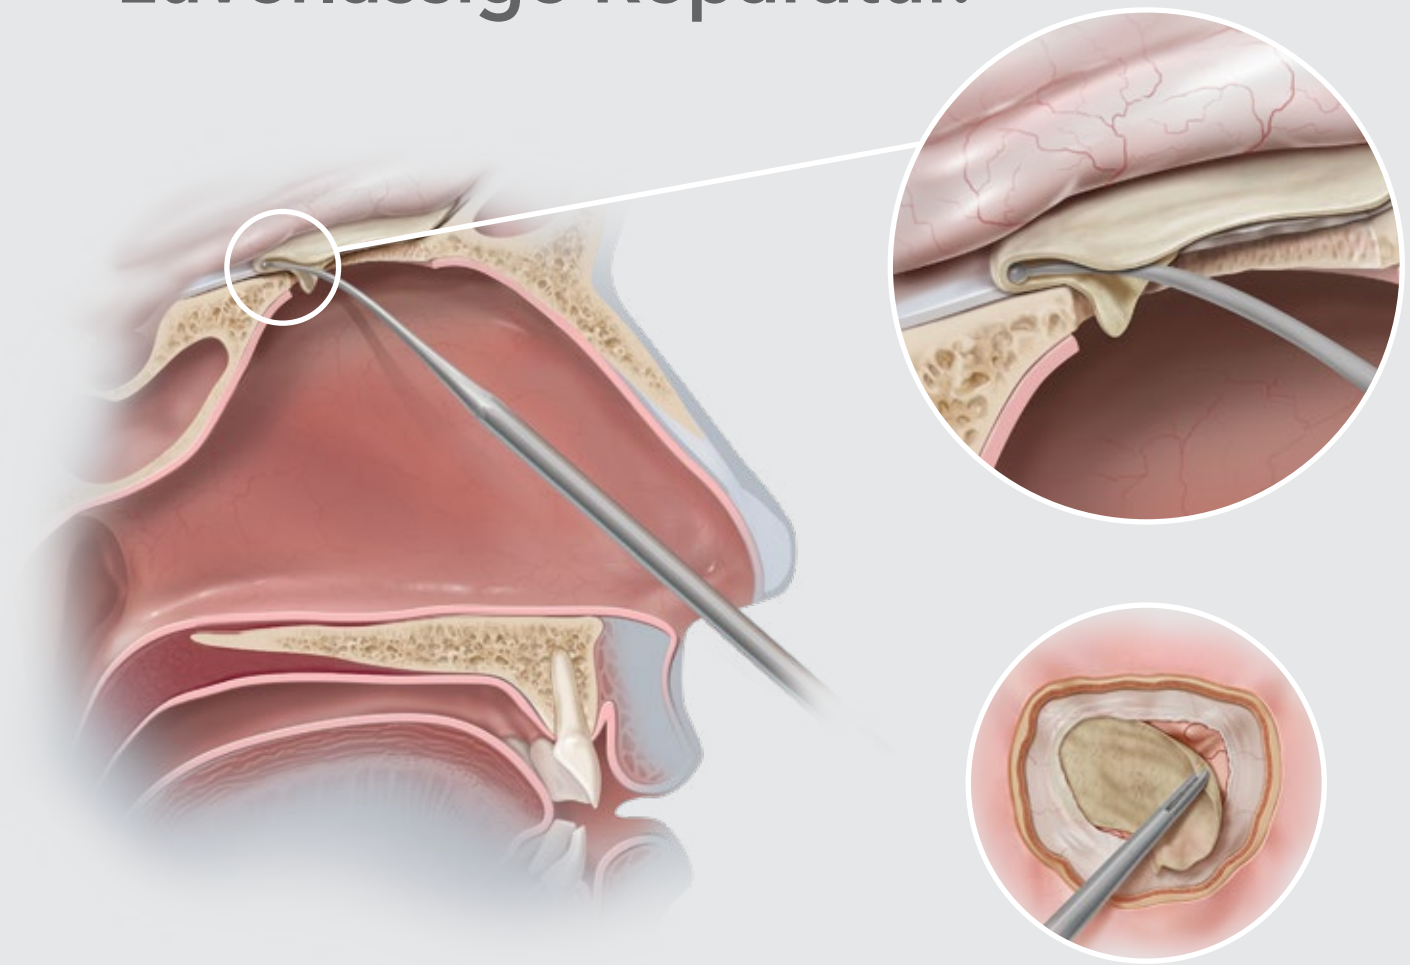

Illustrationen: Lisa Clark.

## Biodesign<sup>®</sup> DURAPLASTY GRAFT

### Stabile Abdichtung

Das Biodesign Duraplastik-Implantat wird vollständig in natürliches Wirtsgewebe umgewandelt, sodass die Leckagerate nach der OP nur 1,7 % beträgt.<sup>1</sup>

### Hervorragende Handhabung

Biodesign-Material ist leicht zu handhaben, quillt durch Rehydrierung nicht auf und faltet sich nicht auf sich selbst auf.<sup>2</sup>

### Fixierung mit oder ohne Naht

Das Biodesign Duraplastik-Implantat lässt sich je nach Präferenz des Arztes mit oder ohne Naht fixieren.

# Biodesign®


## DURAPLASTY GRAFT

### Tipps zur Erzielung optimaler Ergebnisse:

- Eine adäquate Blutzufuhr sicherstellen.
- Implantatgröße so bemessen, dass ein Überlappen des Gewebes möglich ist.
- Implantat vor dem Einsetzen mindestens zwei Minuten rehydrieren.

### Erhältliche Produktgrößen

Abbildung in Originalgröße.



Bestellnummer	Referenznummer	Größe cm	Nominale Dicke mm
Biodesign Duraplastik-Implantat			
G57553	ENT-CBD-1X2-2	1 x 2	0,25
G57554	ENT-CBD-2.5X2.5-2	2.5 x 2.5	0,25
G57555	ENT-CBD-5X5-2	5 x 5	0,25
G57556	ENT-CBD-7X8.5-2	7 x 8.5	0,25

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

### Quellen

1. Bejjani GK, Zabramski J; Durasis Study Group. Safety and efficacy of the porcine small intestinal submucosa dural substitute: results of a prospective multicenter study and literature review. *J Neurosurg.* 2007;106(6):1028-1033.
2. Illing E, Chaaban MR, Riley KO, Woodworth BA. Porcine small intestine submucosal graft for endoscopic skull base reconstruction. *Int Forum Allergy Rhinol.* 2013;3(11):928-932.

Weitere Informationen finden Sie unter [cookmedical.com/otolaryngology](http://cookmedical.com/otolaryngology).

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Iceland: +354 800 7615, [IS.orders@cookmedical.com](mailto:IS.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4