

Monitoraggio affidabile.

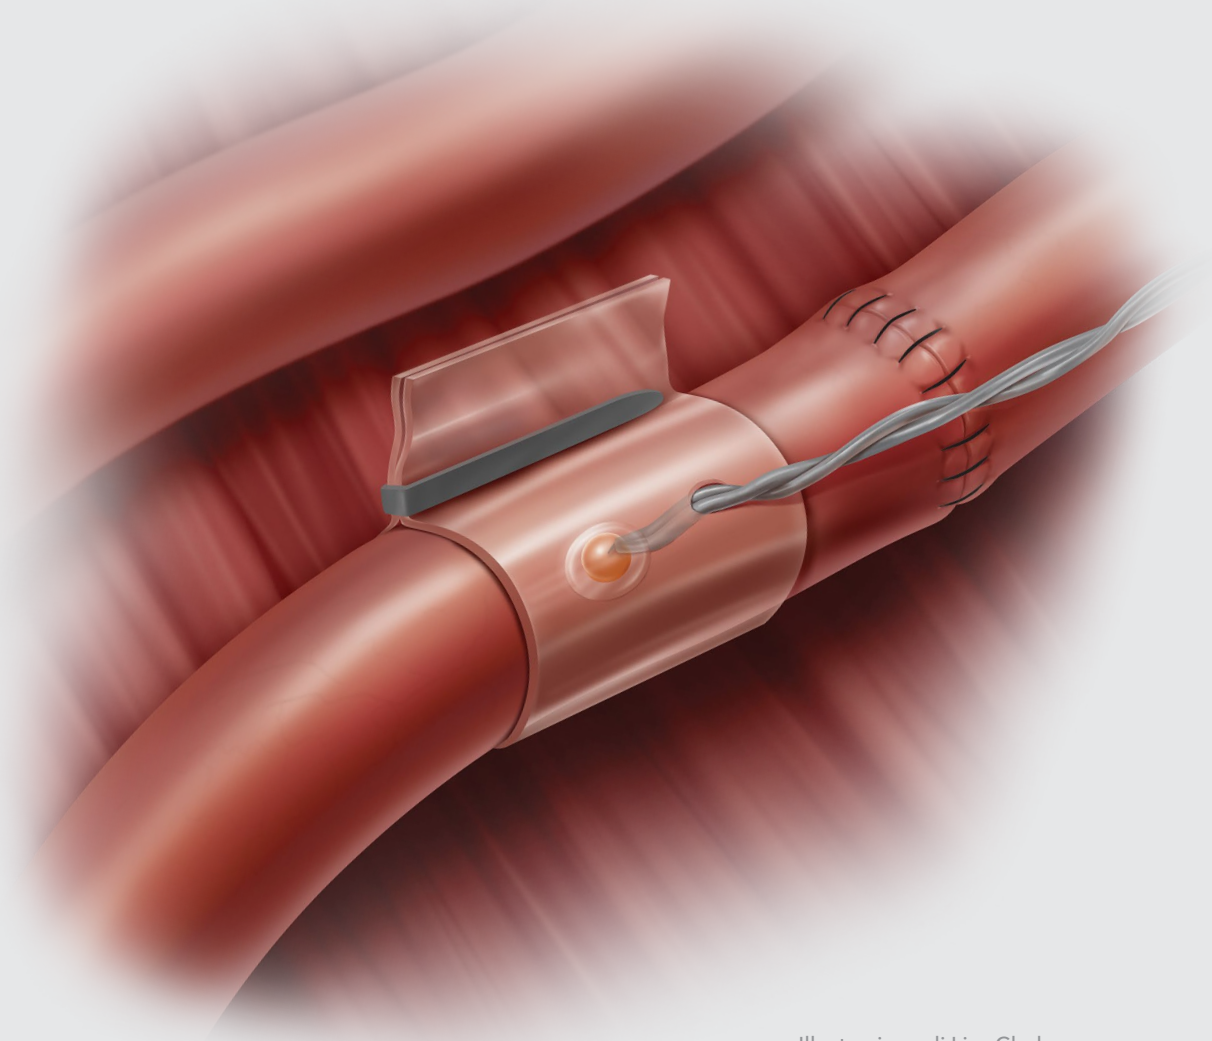


Illustrazione di Lisa Clark

Doppler

BLOOD FLOW MONITORING SYSTEM

Più opzioni di posizionamento

Per il monitoraggio di arterie e/o vene, anastomosi prossimali o distali termino-terminali o termino-laterali.

Accesso ai lembi sommersi

Per il monitoraggio dei lembi sepolti e dei lembi in sedi anatomiche complesse di difficile valutazione clinica rilevando potenzialmente la compromissione dei lembi in modo precoce.¹

Prestazioni comprovate


Vent'anni di evidenze cliniche hanno fatto del sistema Doppler un complemento affidabile per il monitoraggio clinico, che può contribuire a ridurre i tassi di procedure non andate a buon fine,² aumentare quelli di recupero^{2,3} e diminuire le possibilità di ritorno in sala operatoria.⁴



Monitor Doppler per flusso ematico

Utilizzato per il monitoraggio del flusso ematico nei vasi e a seguito di procedure ricostruttive microvascolari, reimpianti e trasferimenti di lembi liberi.


Codice di ordinazione	Codice prodotto
G55328	DP-M350

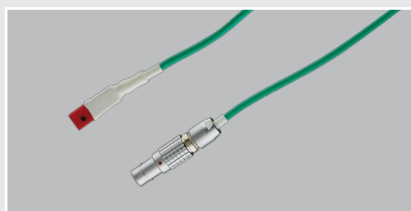

Cavo di prolunga per sistema Doppler

Utilizzato per il monitoraggio del flusso ematico nei vasi e a seguito di procedure ricostruttive microvascolari, reimpianti e trasferimenti di lembi liberi.

Codice di ordinazione	Codice prodotto
G21364	DP-CAB01

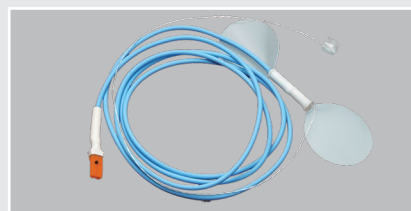

Sonda Doppler Cook-Swartz

Utilizzata per il monitoraggio del flusso ematico nei vasi e a seguito di procedure ricostruttive microvascolari, reimpianti e trasferimenti di lembi liberi.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Lunghezza della cuffia mm
Cuffia lunga		
G03014	DP-SDP002	32
Cuffia standard		
G21363	DP-SDP001	17,4



Caricabatterie per monitor Doppler

Utilizzato con il Monitor Doppler per flusso ematico, include adattatori per prese per Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Australia.

Codice di ordinazione	Codice prodotto
G55458	DP-M350-CHG1



Verificatore di canali/cavi Doppler

Usato per verificare il corretto funzionamento di canali e prolunghe del Monitor Doppler per flusso ematico.

Codice di ordinazione	Codice prodotto
G31632	DP-MCV01

Bibliografia

1. Frost MW, Niumsawatt V, Rozen WM, et al. Direct comparison of postoperative monitoring of free flaps with microdialysis, implantable Cook-Swartz Doppler probe, and clinical monitoring in 20 consecutive patients. *Microsurgery*. 2015;35(4):262-271.
2. Chang TY, Lee YC, Lin YC, et al. Implantable Doppler probes for postoperatively monitoring free flaps: efficacy. A systematic review and meta-analysis. *Plast Reconstr Surg Glob Open*. 2016;4(11):e1099.
3. Lenz Y, Gross R, Penna V, et al. Evaluation of the implantable Doppler probe for free flap monitoring in lower limb reconstruction. *J Reconstr Microsurg*. 2018;34(3):218-226.
4. Wax MK. The role of the implantable Doppler probe in free flap surgery. *Laryngoscope*. 2014;124(suppl 1):S1-S12.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web cookmedical.eu/doppler.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A-4